


MEDVIE


Date du test: 10/07/2025 10:38:18  
Durée: 5mn 46s  
Type test: Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Données Patient   | PA JACOBUS        |
|-------------------|-------------------|
| Date de naissance | 03/11/1993        |
| Age               | 31                |
| Société           | SA                |
| ID                | 25071010254046421 |

| Audiomètre                     |
|--------------------------------|
| Type: Audio 820M V2,211        |
| Numéro de série: 2111EAT690093 |
| Date Calibration : 30/11/2021  |

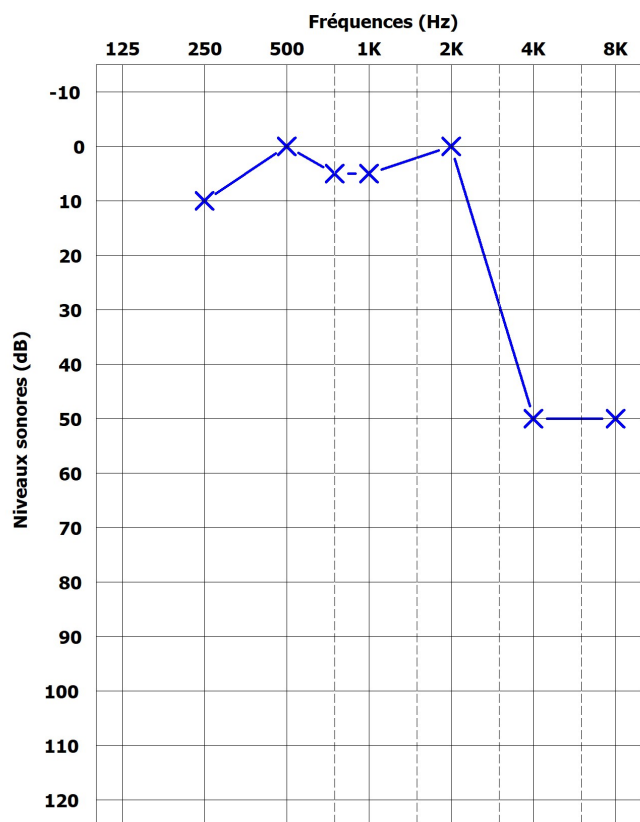

Oreille Gauche

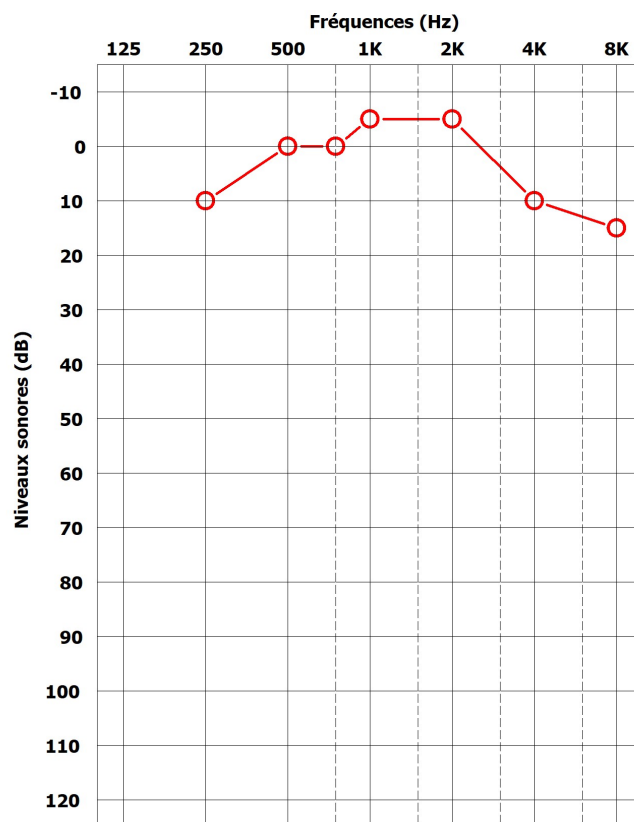

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 10  | 0   | 5   | 5  |     | 0  |    | 50 |    | 50 |
| CA Droit  |     | 10  | 0   | 0   | -5 |     | -5 |    | 10 |    | 15 |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 13,8 dB | --- |
| CA Droit        | 0,0 dB  | --- |

Notes