


MEDVIE


Date du test: 10/06/2025 11:33:35
Durée: 1mn 27s
Type test Manuel
Continu

Données Patient		BEUKES ROLAND
Date de naissance	20/11/1989	
Age	35	
Société	SA	
ID	25061009352953388	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

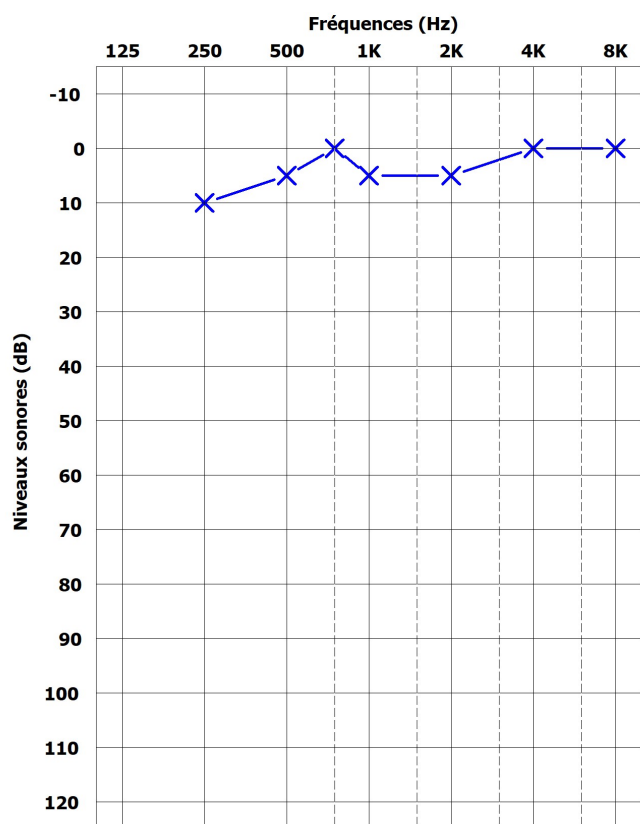

Oreille Gauche

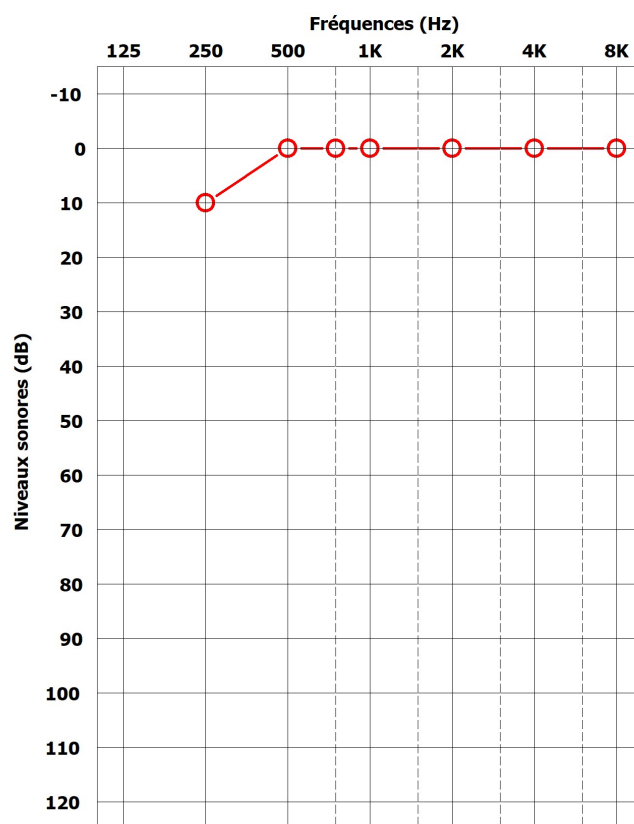

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	5	0	5		5		0		0
CA Droit		10	0	0	0		0		0		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	3,8 dB	---
CA Droit	0,0 dB	---

Notes