

MEDVIE

Date du test: 13/06/2025 11:24:46
Durée: 6mn 37s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard


Données Patient

KYONI NONGO


Date de naissance: 09/08/1991
Age: 33
Société: SA
ID: 25061311200739038

Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

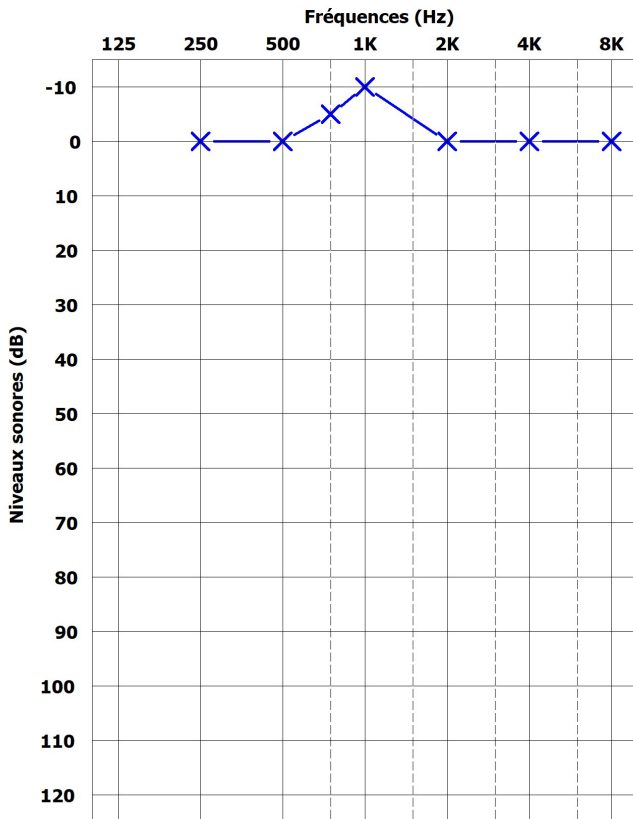

Oreille Gauche

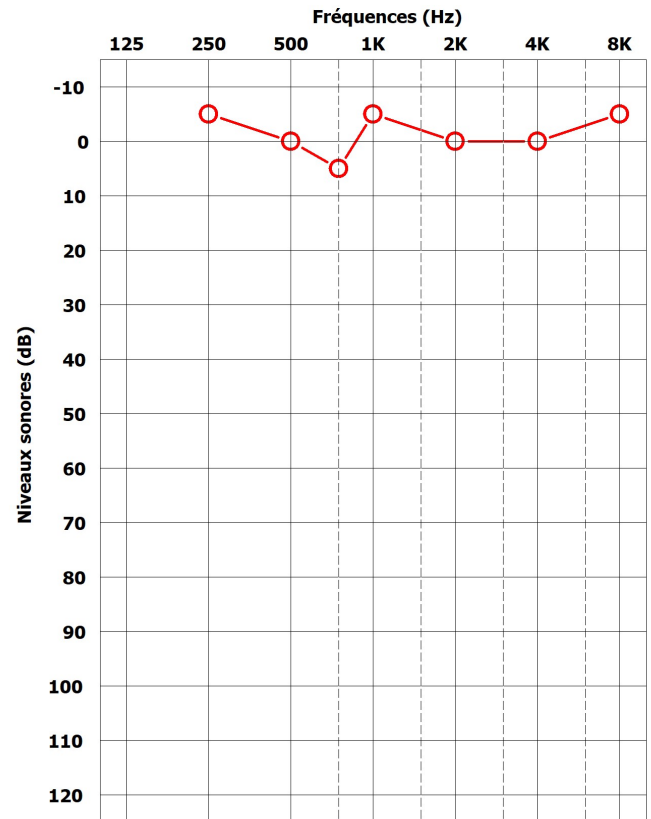

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		0	0	-5	-10		0		0		0
CA Droit		-5	0	5	-5		0		0		-5

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	-2,5 dB	---
CA Droit	-1,3 dB	---

Notes