


MEDVIE

Date du test: 18/07/2025 11:42:06

Durée: 7mn 59s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

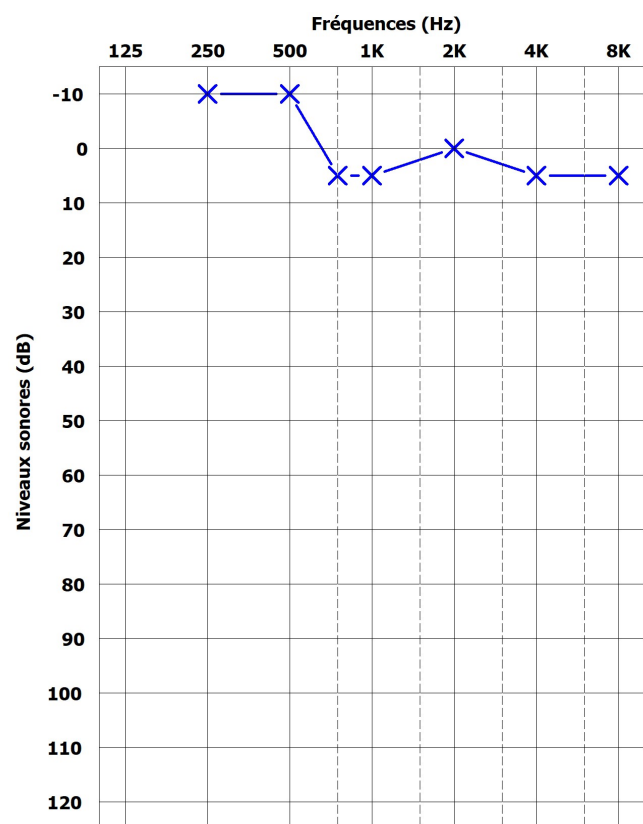

Oreille Gauche

Données Patient	
DIALLO MAMADOU SAI IONI	
Date de naissance	01/01/1990
Age	35
Société	RKMC
ID	25071811385555134

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

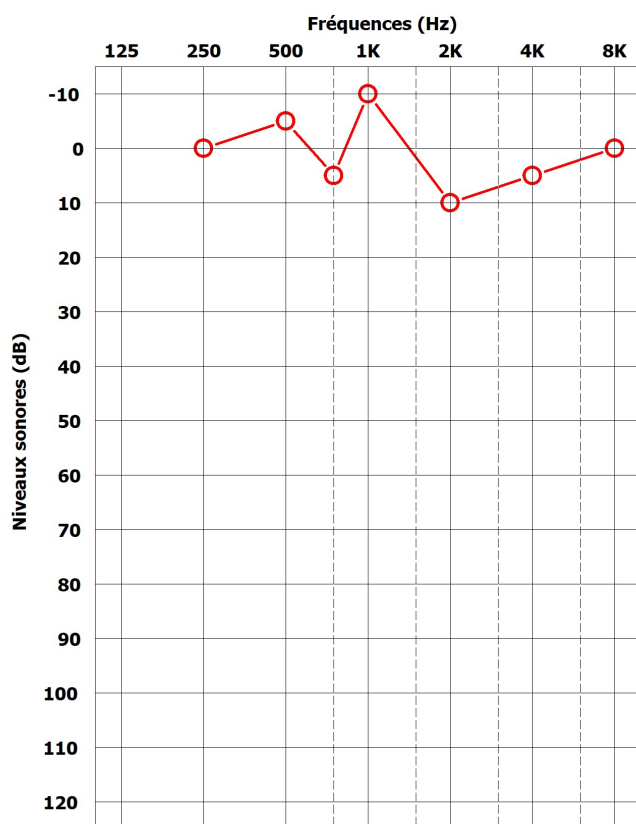

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-10	-10	5	5		0		5		5
CA Droit		0	-5	5	-10		10		5		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	0,0 dB	---
CA Droit	0,0 dB	---

Notes