


MEDVIE


Date du test: 04/08/2025 12:25:42

Durée: 4mn 44s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

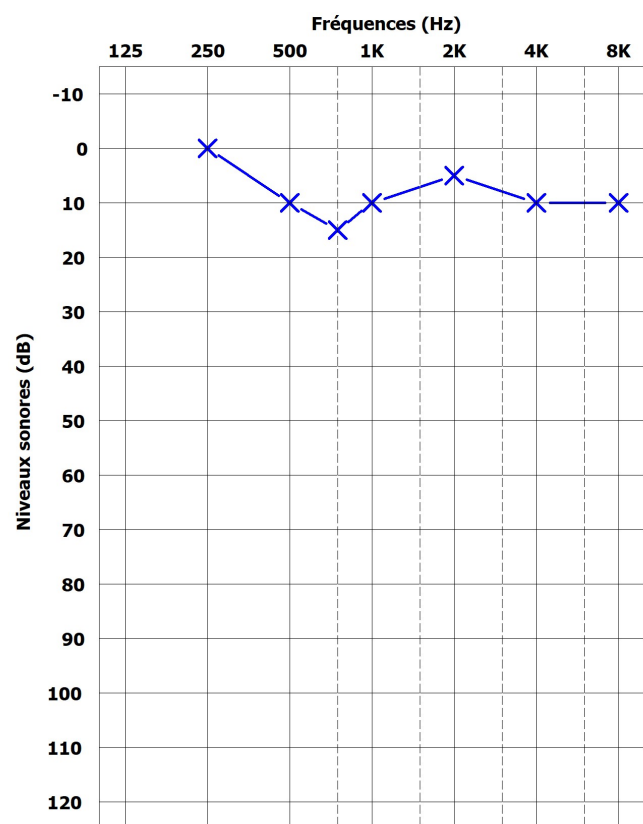

Oreille Gauche

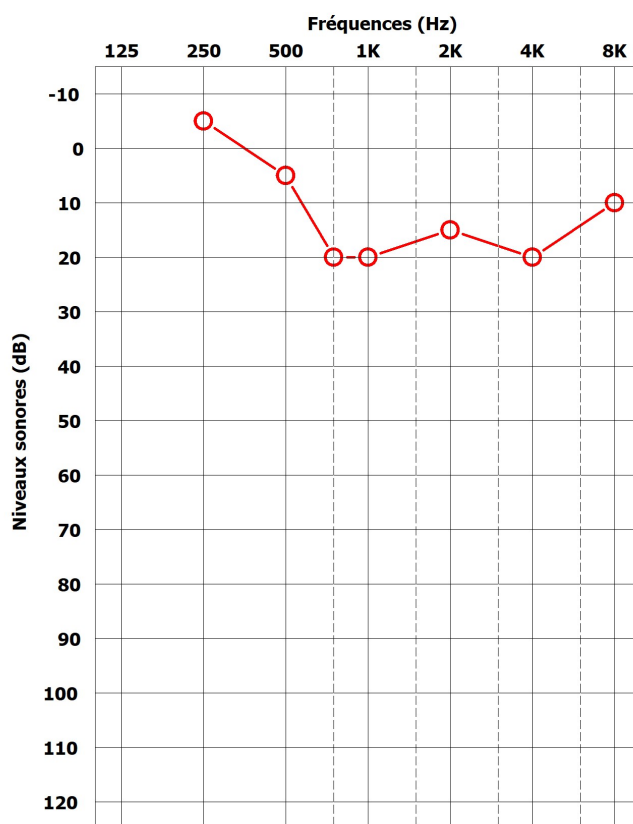

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		0	10	15	10		5		10		10
CA Droit		-5	5	20	20		15		20		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes

Données Patient	SY SAVANE MUHAMED PHILIPPE
Date de naissance	07/08/1988
Age	36
Société	RKMC
ID	25080412231824695

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021