

MEDVIE


Date du test: 28/07/2025 12:04:10

Durée: 4mn 27s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	CAMARA MOHAMED
Date de naissance	26/07/1999
Age	26
Société	EHC CONSTRUCTION
ID	25072812010038525

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

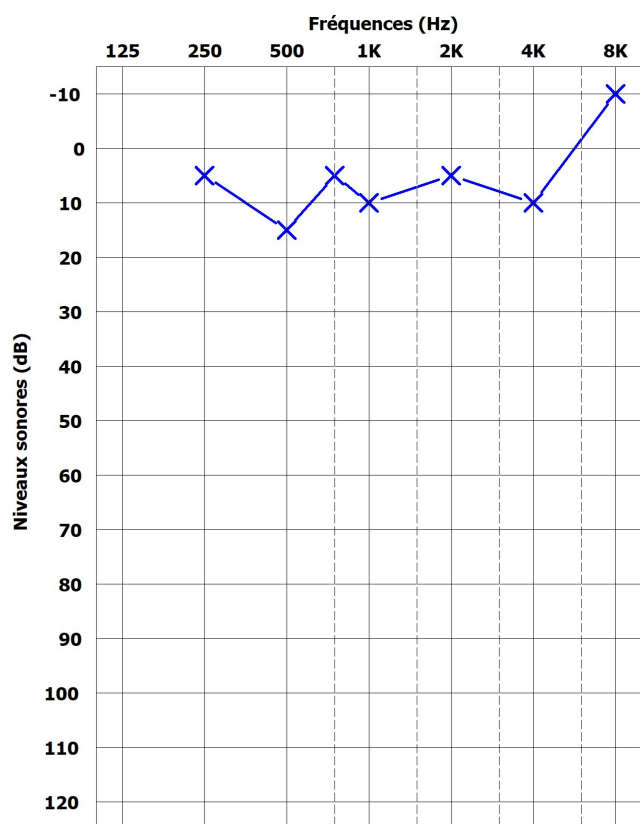

Oreille Gauche

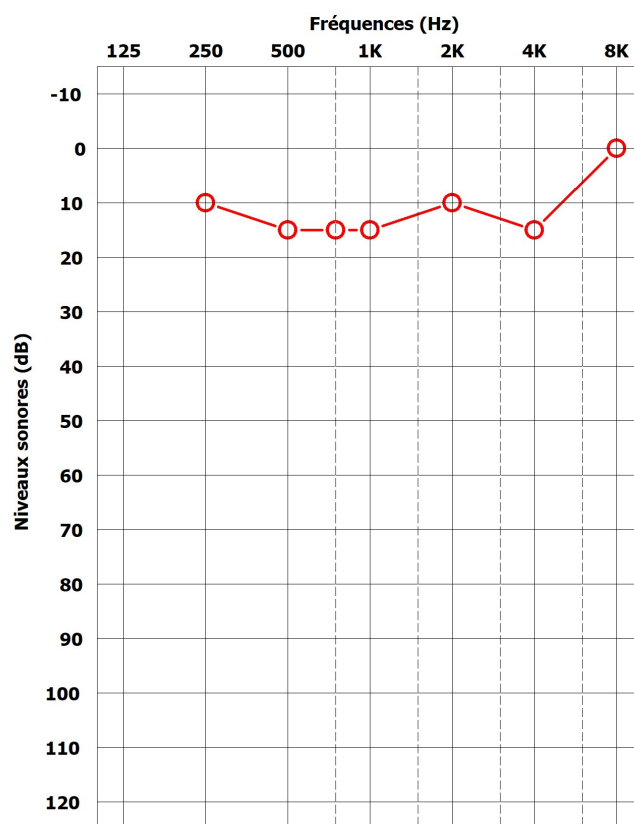

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	15	5	10		5		10		-10
CA Droit		10	15	15	15		10		15		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes