


MEDVIE


Date du test: 29/07/2025 10:56:41

Durée: 6mn 06s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

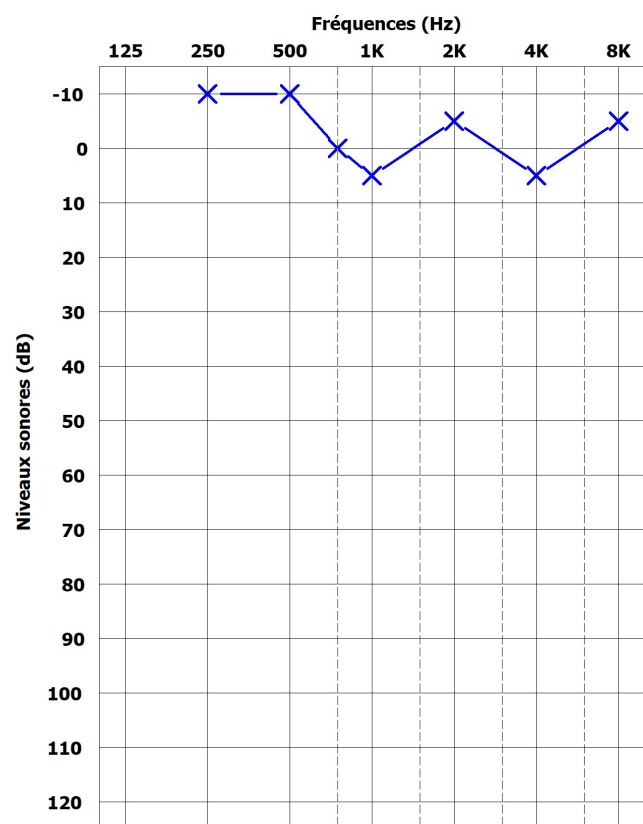

Oreille Gauche

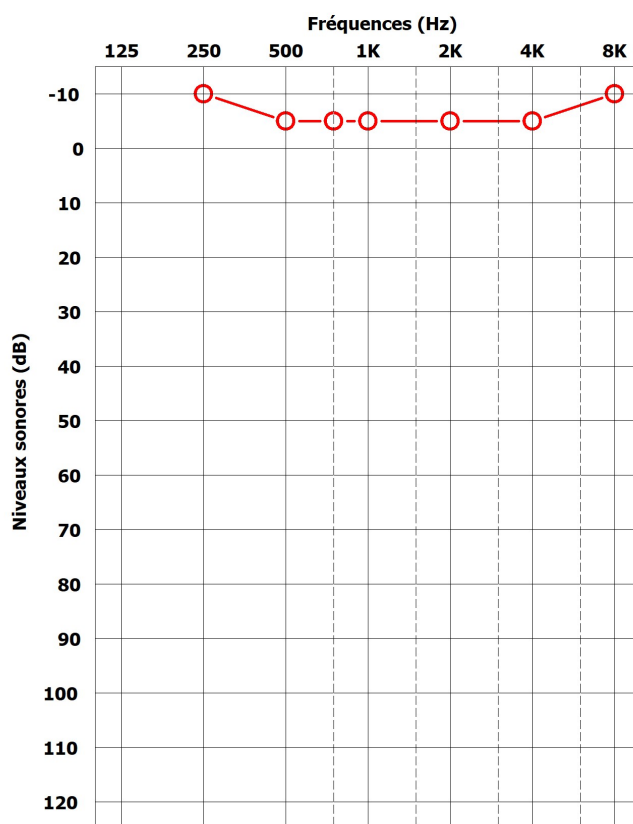

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-10	-10	0	5		-5		5		-5
CA Droit		-10	-5	-5	-5		-5		-5		-10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	-1,3 dB	---
CA Droit	-5,0 dB	---

Notes

Données Patient		DIALLO THIERNO MAMOUIDOU
Date de naissance	01/01/1990	
Age	35	
Société	EHC	
ID	25072910414242572	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021