


MEDVIE


Date du test: 28/07/2025 11:47:36

Durée: 6mn 45s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

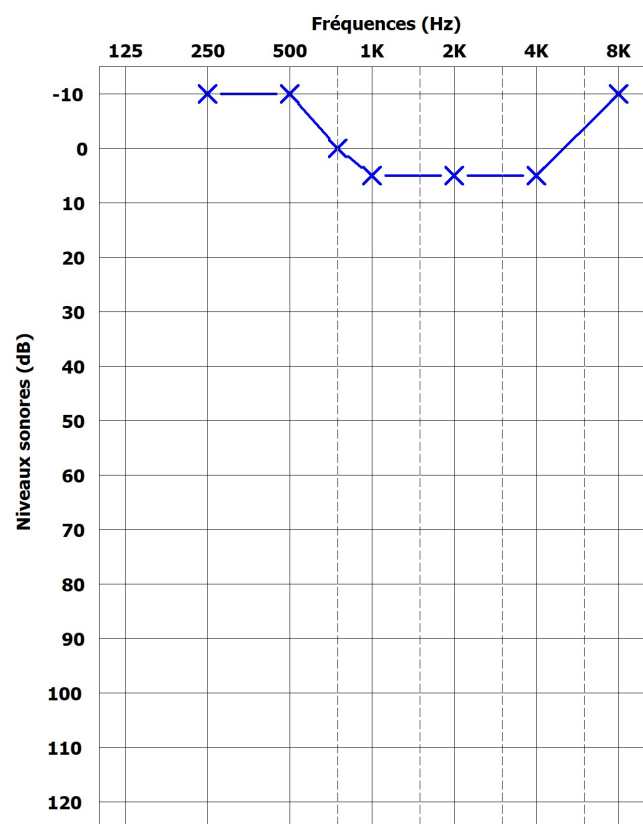

Oreille Gauche

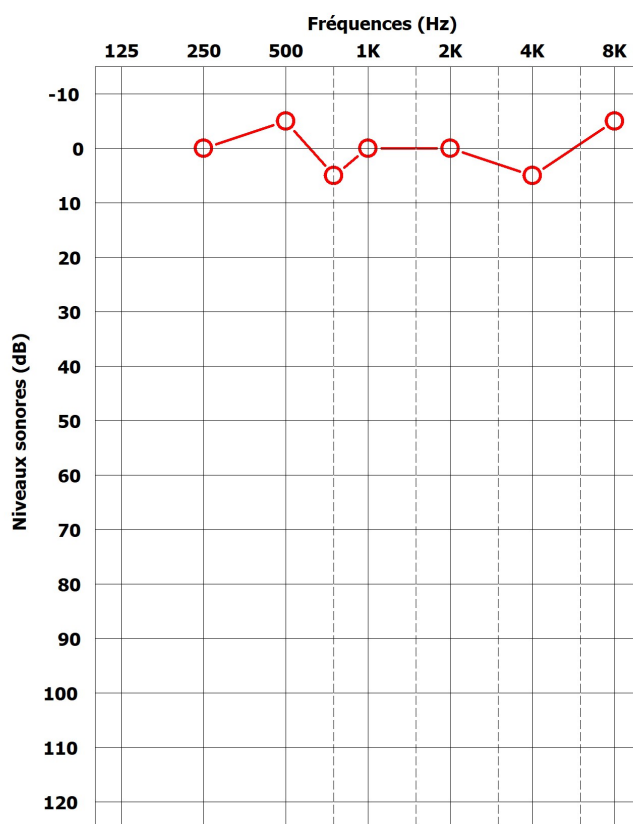

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-10	-10	0	5		5		5		-10
CA Droit		0	-5	5	0		0		5		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	1,3 dB	---
CA Droit	0,0 dB	---

Notes

Données Patient	DIALLO TAMSIR
Date de naissance	10/08/1996
Age	28
Société	EHC CONSTRUCTION
ID	25072811434854741

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021