


MEDVIE


Date du test: 22/08/2025 13:23:14

Durée: 6mn 34s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

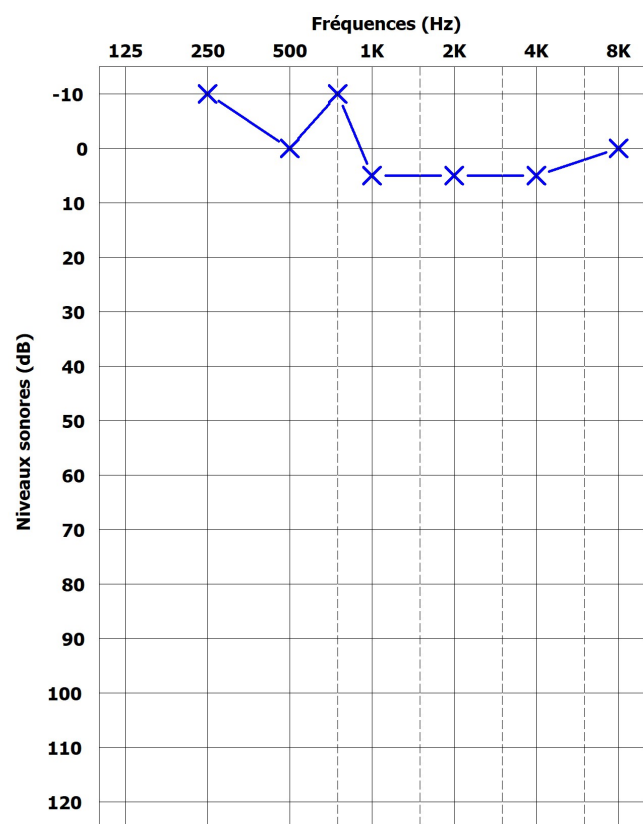

Oreille Gauche

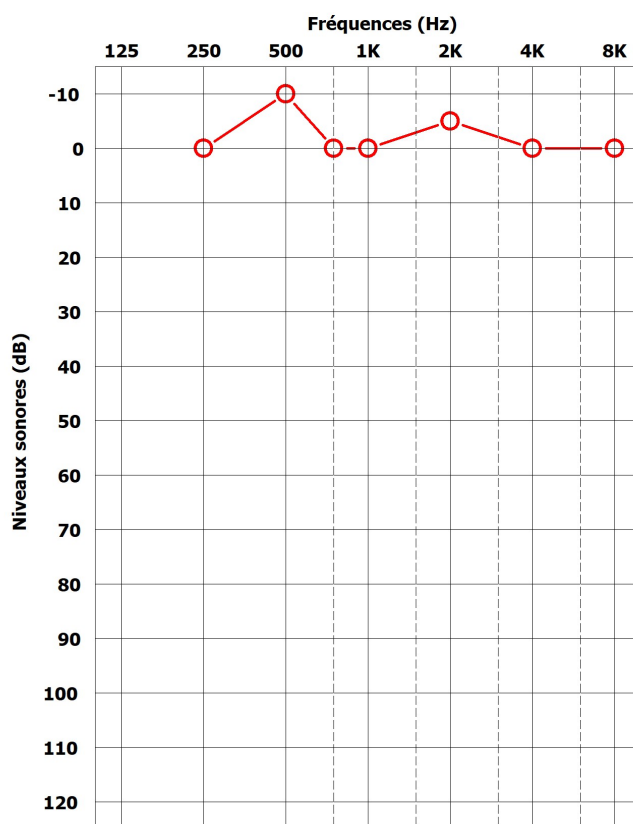

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-10	0	-10	5		5		5		0
CA Droit		0	-10	0	0		-5		0		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	3,8 dB	---
CA Droit	-3,8 dB	---

Notes

Données Patient	FOFANA LAYE
Date de naissance	06/04/2006
Age	19
Société	EHC
ID	25082213194669610

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021