


MEDVIE


Date du test: 29/08/2025 12:42:14

Durée: 8mn 10s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

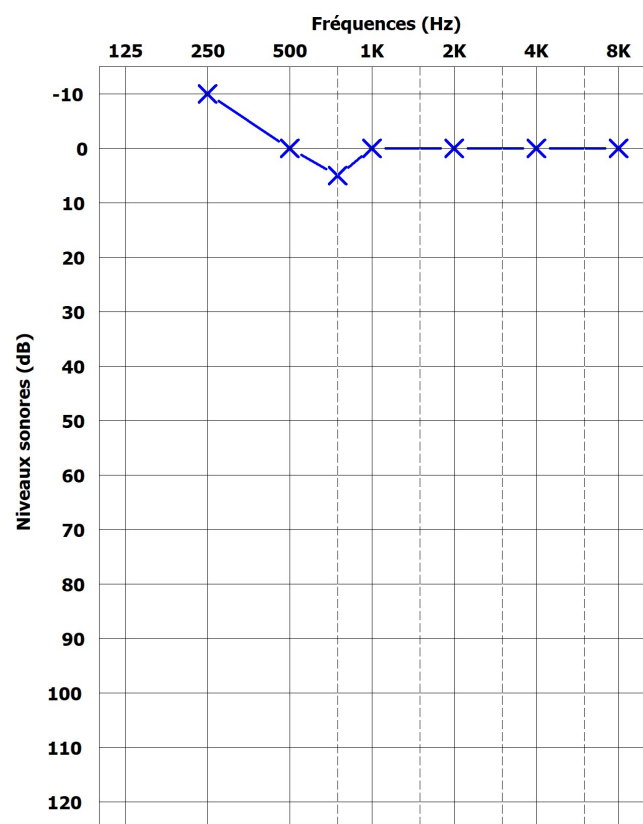

Oreille Gauche

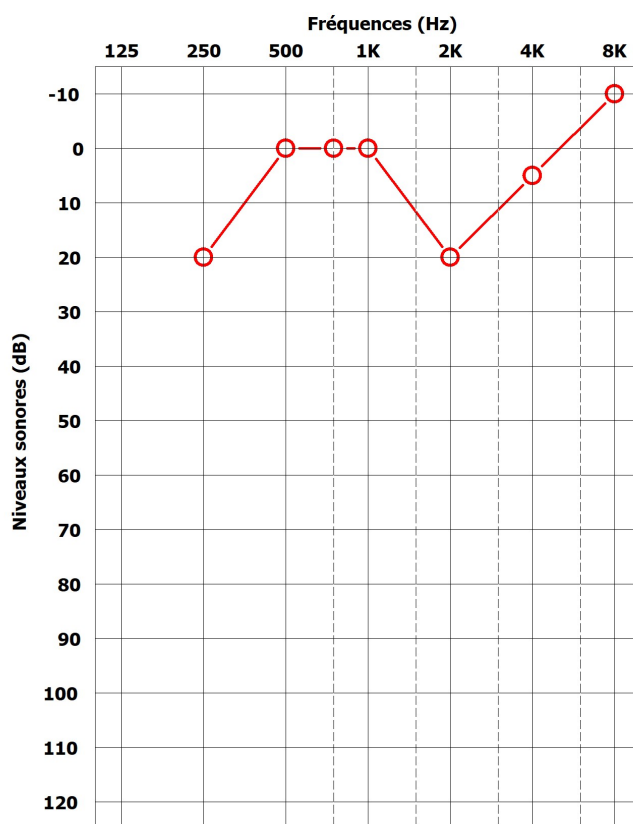

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-10	0	5	0		0		0		0
CA Droit		20	0	0	0		20		5		-10

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	0,0 dB	---
CA Droit	6,3 dB	---

Notes

Données Patient	
SOW MAMADOU SAIDOU	
Date de naissance	05/03/1997
Age	28
Société	CEGEDI
ID	25082912395966216

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021