

MEDVIE


Date du test: 11/09/2025 10:40:06

Durée: 3mn 16s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		ONIVOGUI FANTA
Date de naissance	16/11/2001	
Age	23	
Société	MAYELIA	
ID	25091110370717984	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

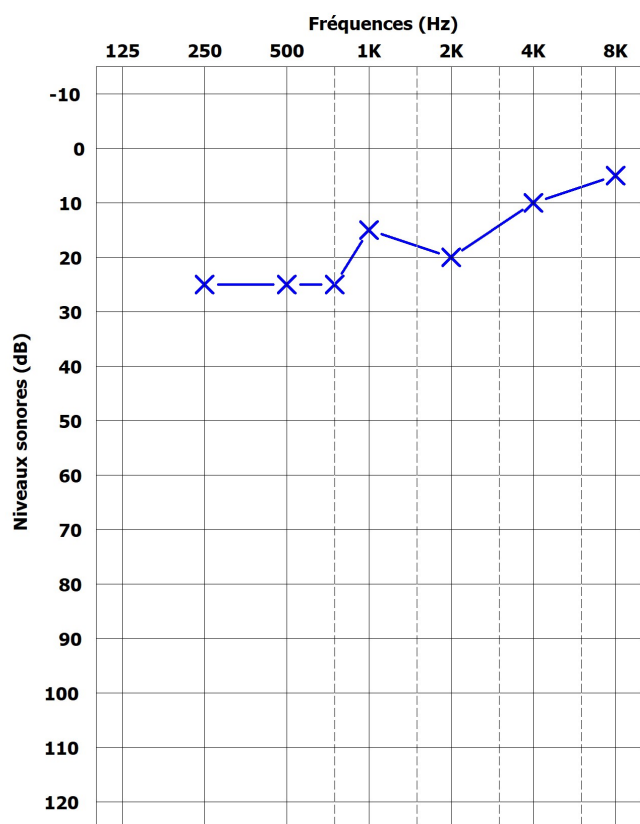

Oreille Gauche

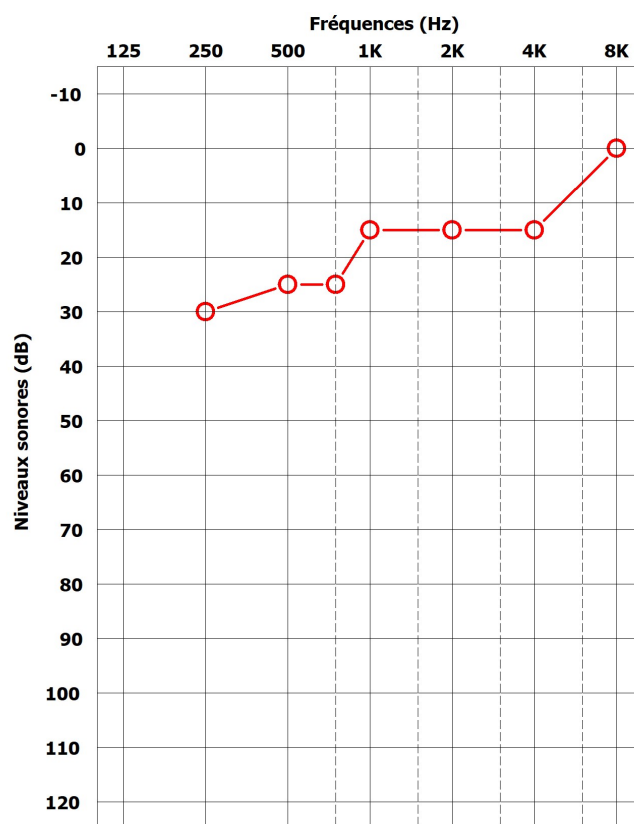

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25	25	15		20		10		5
CA Droit		30	25	25	15		15		15		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes