


MEDVIE


Date du test: 11/09/2025 11:10:54

Durée: 5mn 10s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

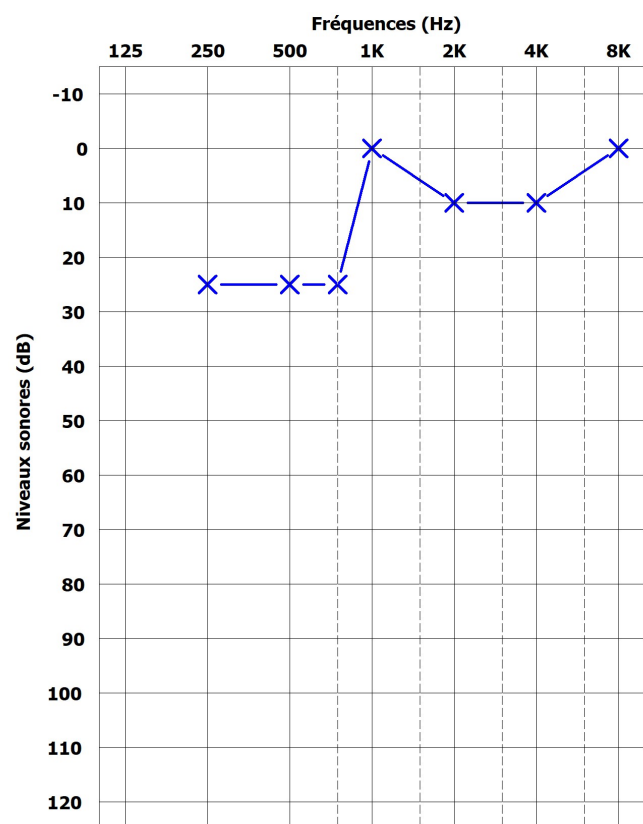

Oreille Gauche

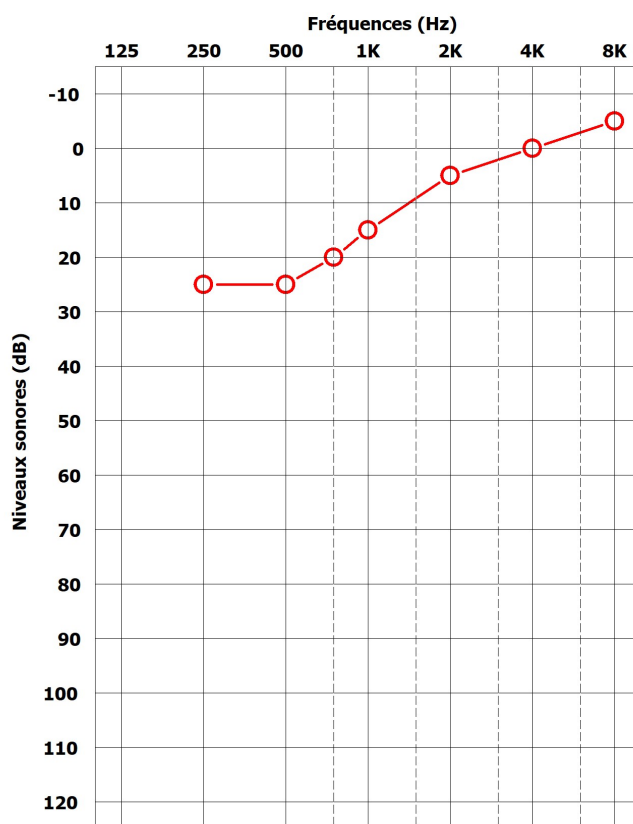

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25	25	0		10		10		0
CA Droit		25	25	20	15		5		0		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes

Données Patient	DIENG KADIATOU
Date de naissance	04/04/1987
Age	38
Société	MAYELIA
ID	25091111085674074

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021