


MEDVIE


Date du test: 11/09/2025 10:32:06
Durée: 3mn 04s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		SYLLA FANTA
Date de naissance	13/01/2000	
Age	25	
Société	MAYELIA	
ID	25091110284296495	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

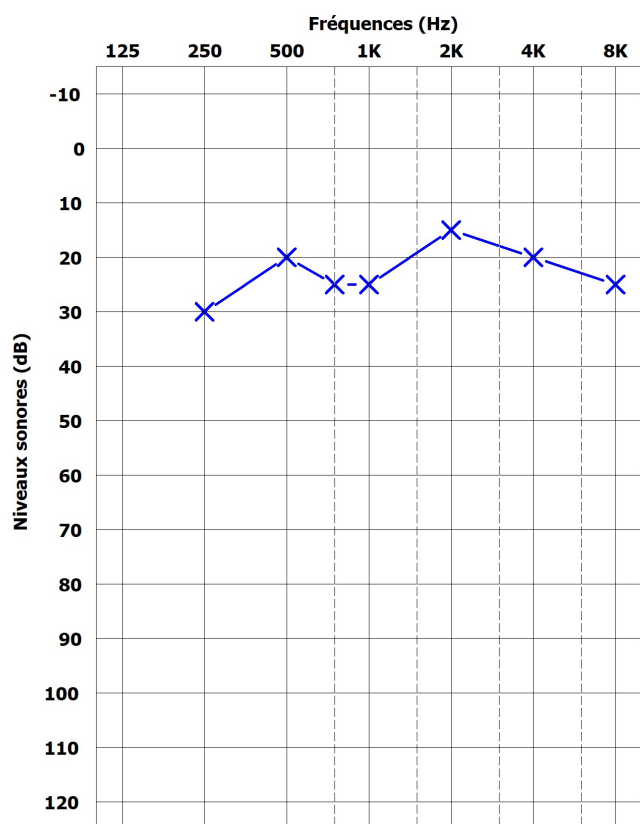

Oreille Gauche

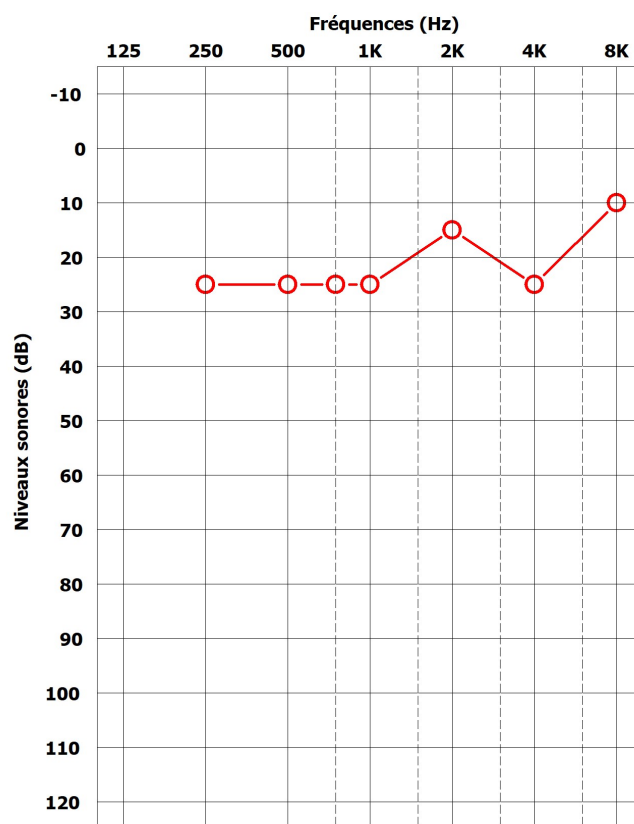

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	20	25	25		15		20		25
CA Droit		25	25	25	25		15		25		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	22,5 dB	---

Notes