

MEDVIE

Date du test: 11/09/2025 09:40:50
Durée: 3mn 30s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard


Données Patient

KANDE KABINET


Date de naissance: 17/10/1992
Age: 32
Société: MAYELIA
ID: 25091109380473749

Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

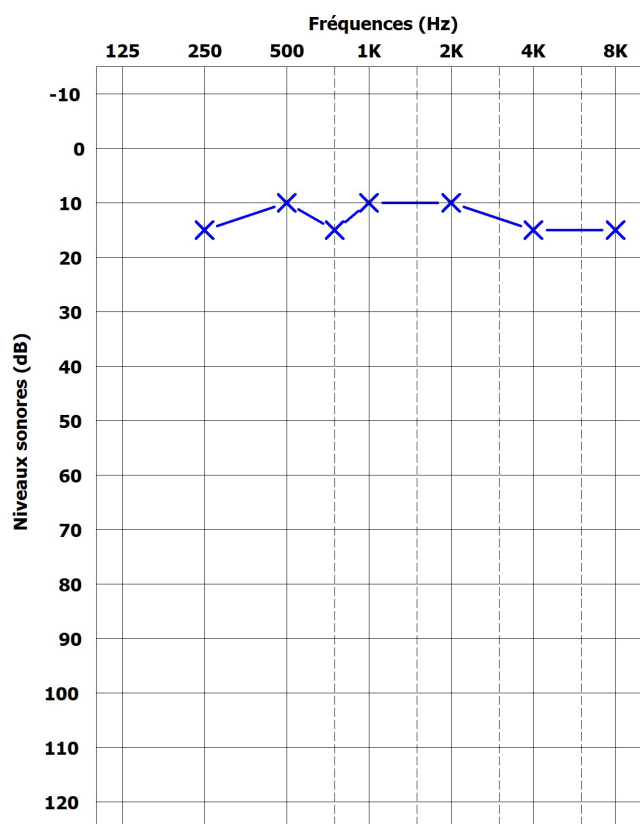

Oreille Gauche

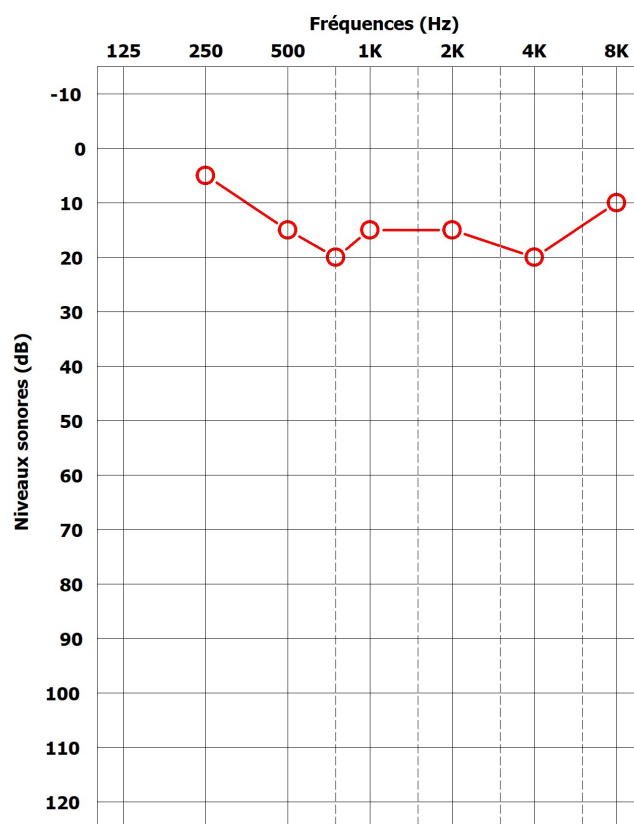

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	10	15	10		10		15		15
CA Droit		5	15	20	15		15		20		10

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes