


MEDVIE

Date du test: 25/09/2024 13:56:38

Durée: 4mn 26s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

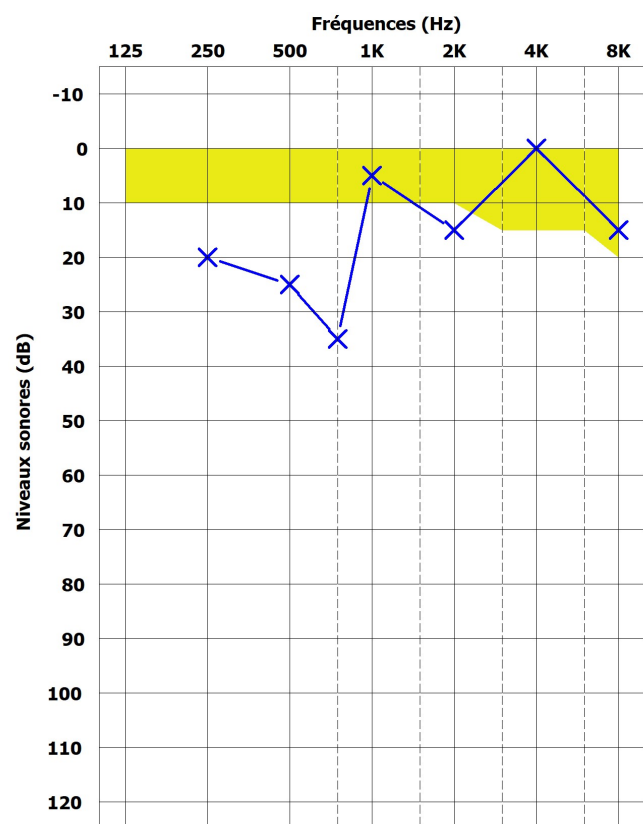

Oreille Gauche

Données Patient	
CAMARA FATOUMATA	
Date de naissance	03/03/1982
Age	42
Société	MEDVIE
ID	24092513450610342

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

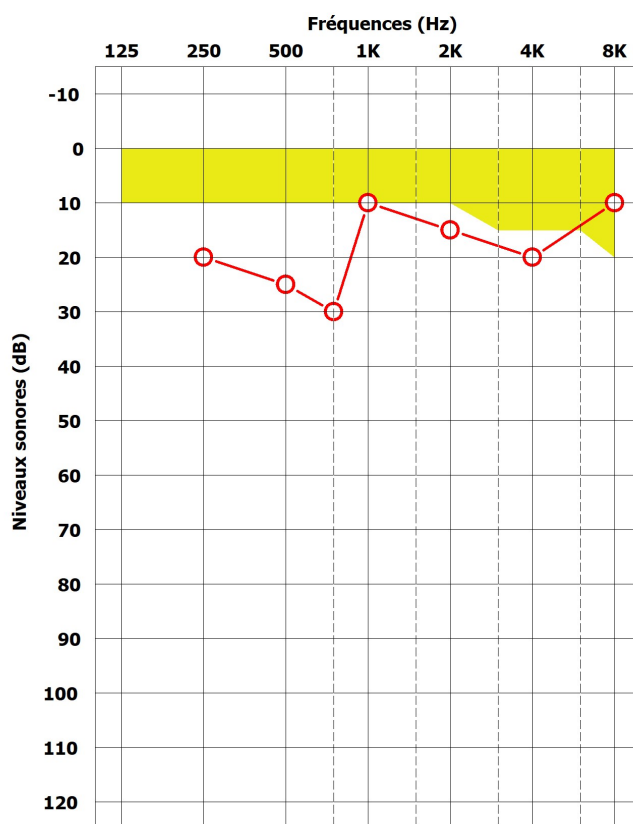

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	25	35	5		15		0		15
CA Droit		20	25	30	10		15		20		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes