


MEDVIE


Date du test: 30/04/2024 09:44:29
Durée: 11mn 32s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	TOURE ANTOINE
Date de naissance	10/03/1993
Age	31
Société	MED VIE
ID	24043009421652365

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

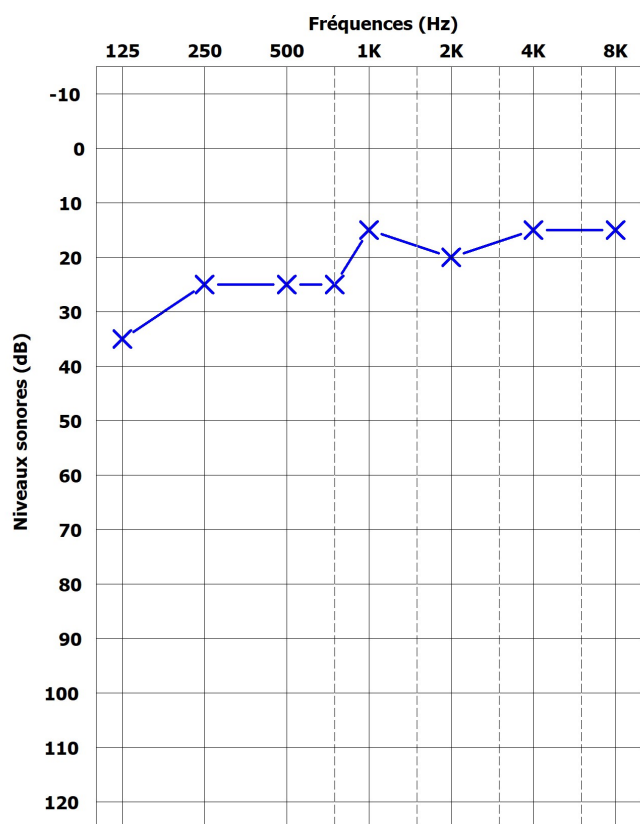

Oreille Gauche

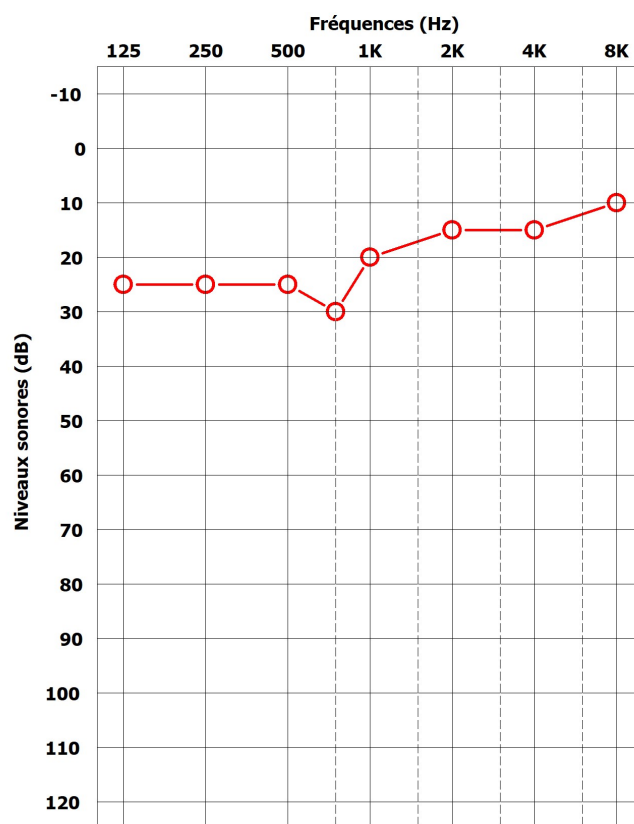

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	35	25	25	25	15		20		15		15
CA Droit	25	25	25	30	20		15		15		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes