

Données Patient

CAMARA FANTA

Date de naissance 28/11/1984
Age 39
Société MED VIE
ID 24022911361538501


Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021


Date du test: 29/02/2024 11:39:53

Durée: 4mn 21s

Type test Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

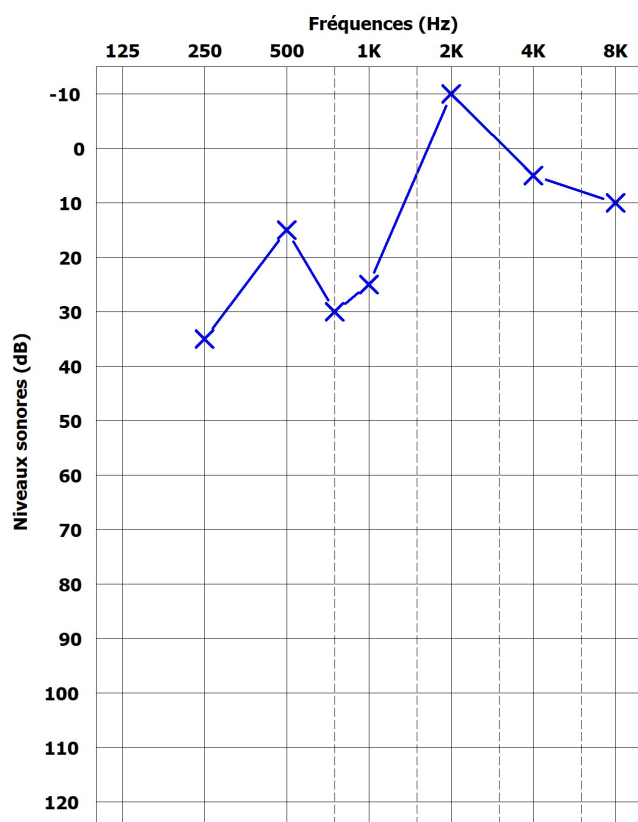

Oreille Gauche

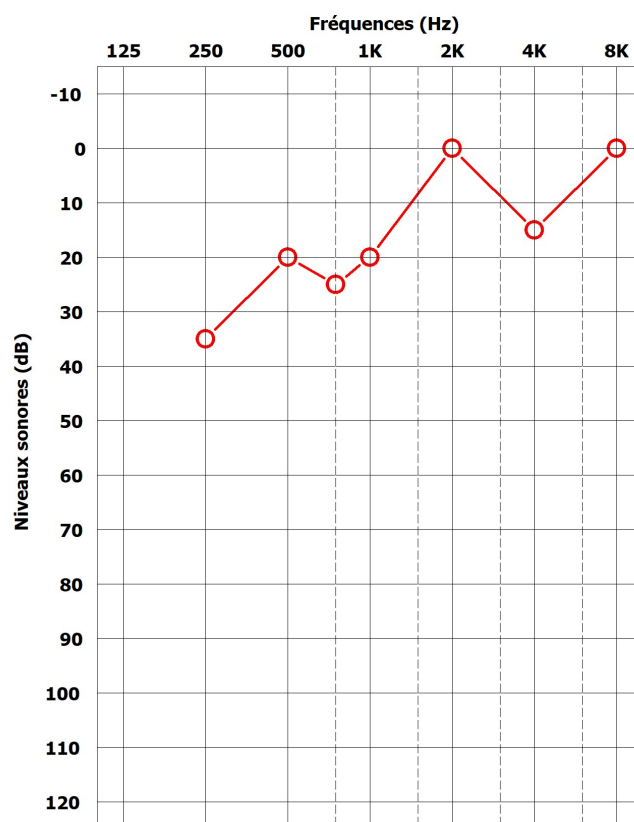

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		35	15	30	25		-10		5		10
CA Droit		35	20	25	20		0		15		0

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes