


MEDVIE


Date du test: 01/02/2024 11:12:58
Durée: 3mn 31s
Type test Manuel
Continu

Données Patient	
DIALLO ALSENY DAVID	
Date de naissance	11/10/1991
Age	32
Société	MEDVIE
ID	24020111090821984

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

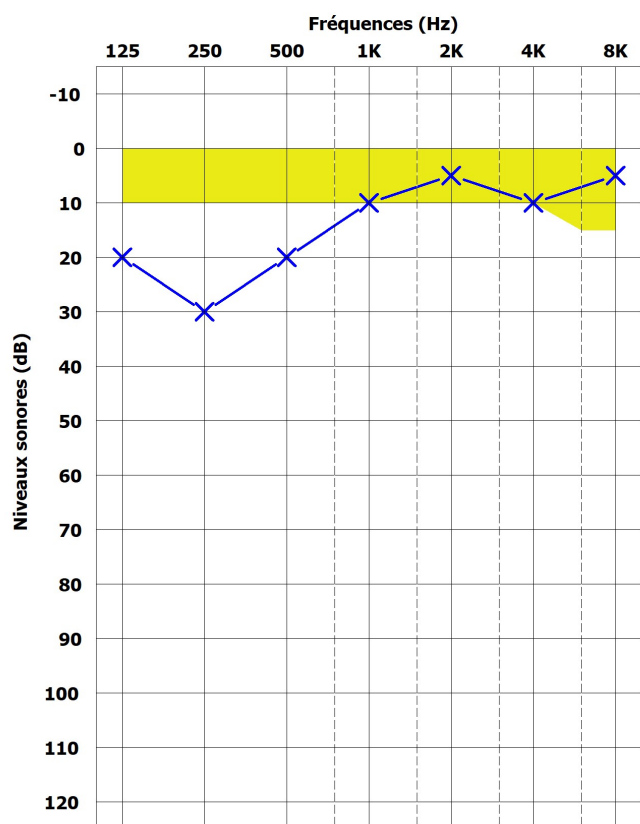

Oreille Gauche

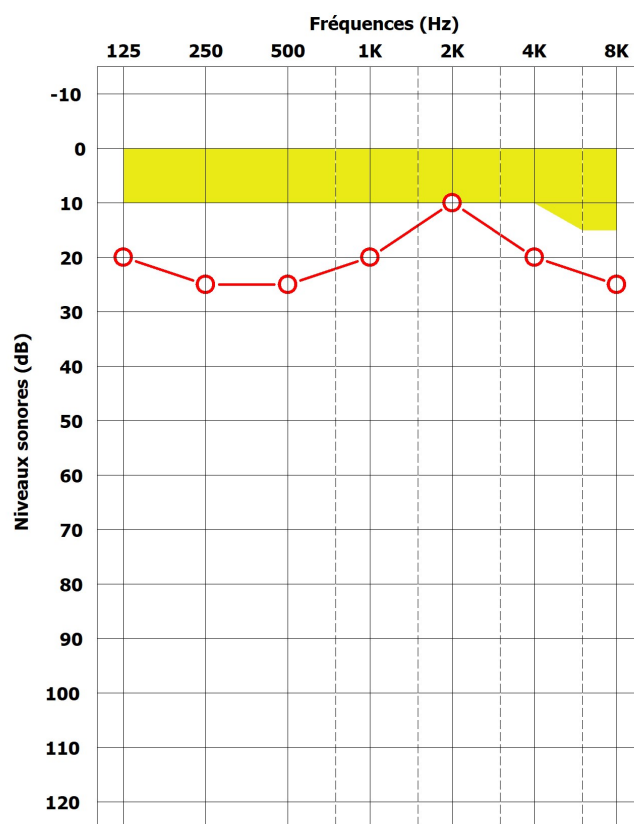

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	30	20		10		5		10		5
CA Droit	20	25	25		20		10		20		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes