


MEDVIE


Date du test: 27/01/2024 10:24:07
Durée: 3mn 34s
Type test Manuel
Continu

Données Patient	BERETE AMADOU
Date de naissance	21/01/1993
Age	31
Société	FEG SARL
ID	24012710202289050

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

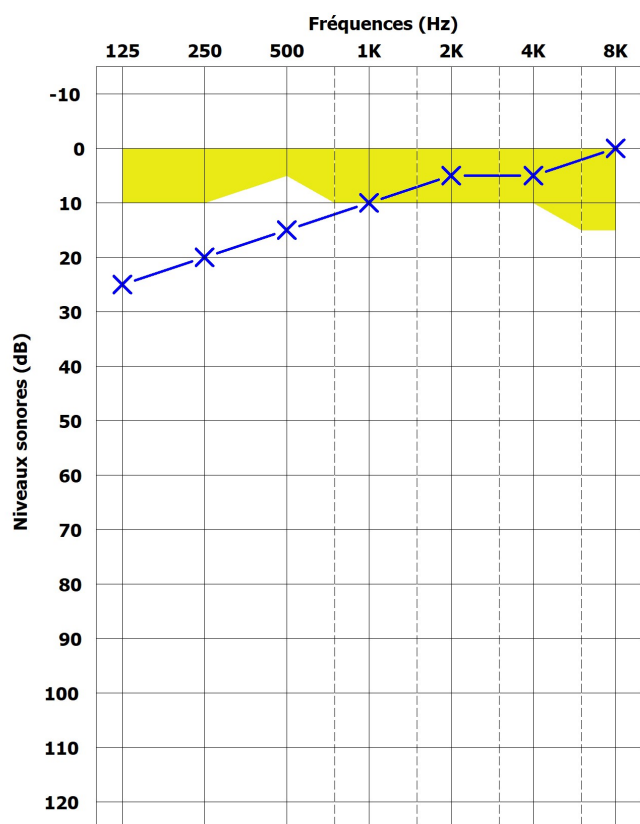

Oreille Gauche

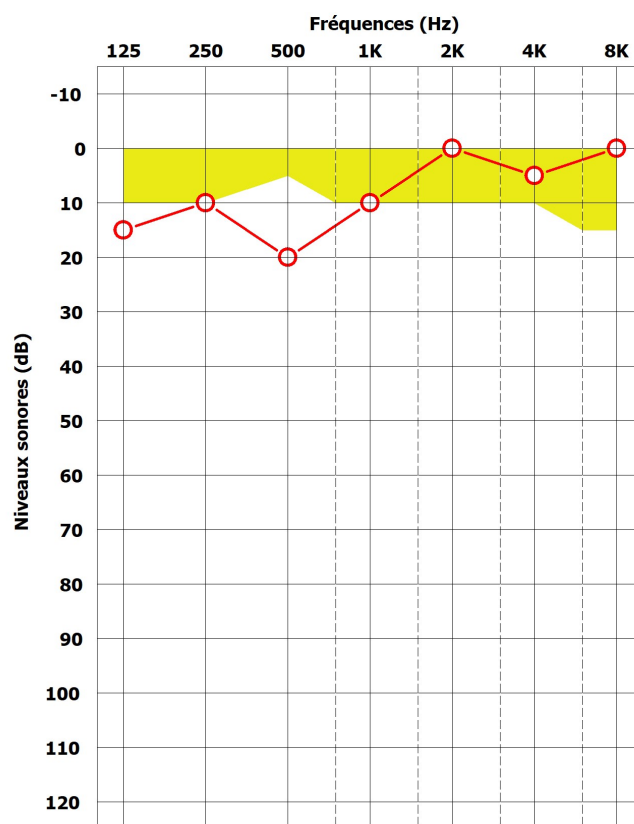

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	20	15		10		5		5		0
CA Droit	15	10	20		10		0		5		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes