


MEDVIE


Date du test: 10/02/2024 09:58:09
Durée: 3mn 39s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		TRAORE SIDIKI
Date de naissance		01/07/1987
Age		36
Société		FEG SARL
ID		24021009530714313

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

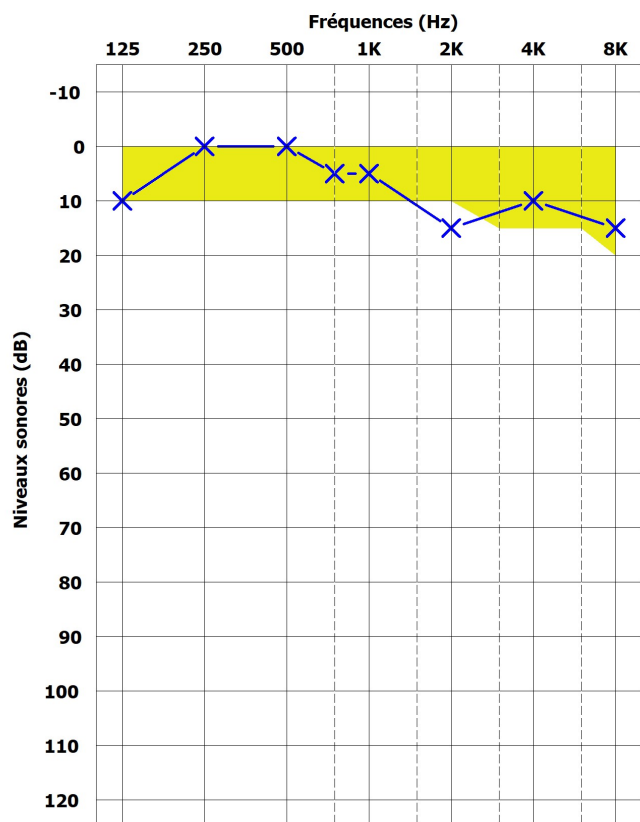

Oreille Gauche

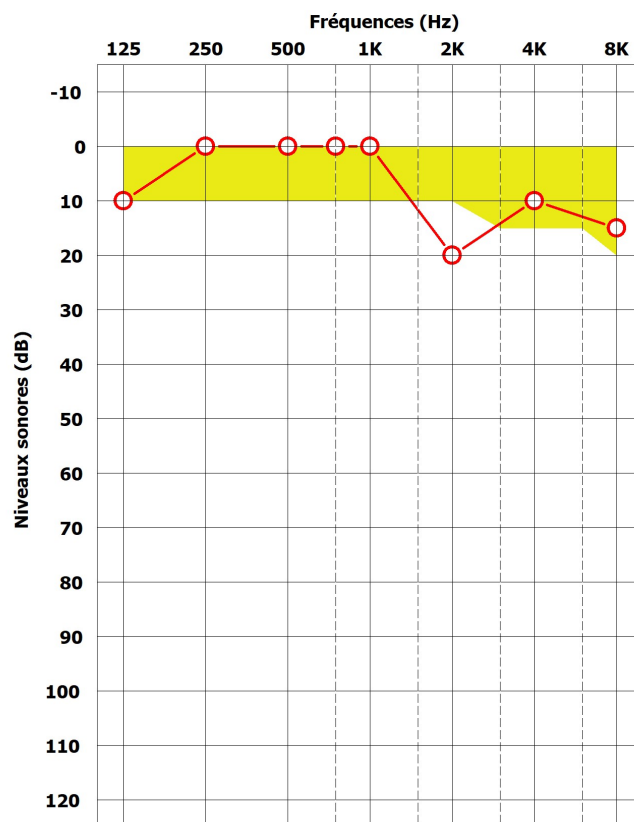

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	10	0	0	5	5		15		10		15
CA Droit	10	0	0	0	0		20		10		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	7,5 dB	---
CA Droit	7,5 dB	---

Notes