



| Données Patient   | CAMARA MAMADY     |
|-------------------|-------------------|
| Date de naissance | 01/01/1980        |
| Age               | 44                |
| Société           | FEG-SARL          |
| ID                | 24012709151722912 |

Date du test: 27/01/2024 09:20:55  
 Durée: 5mn 27s  
 Type test: Auto  
 Normal  
 Continu  
 Scén. Standard

| Audiomètre                     |
|--------------------------------|
| Type: Audio 820M V2,211        |
| Numéro de série: 2111EAT690093 |
| Date Calibration : 30/11/2021  |

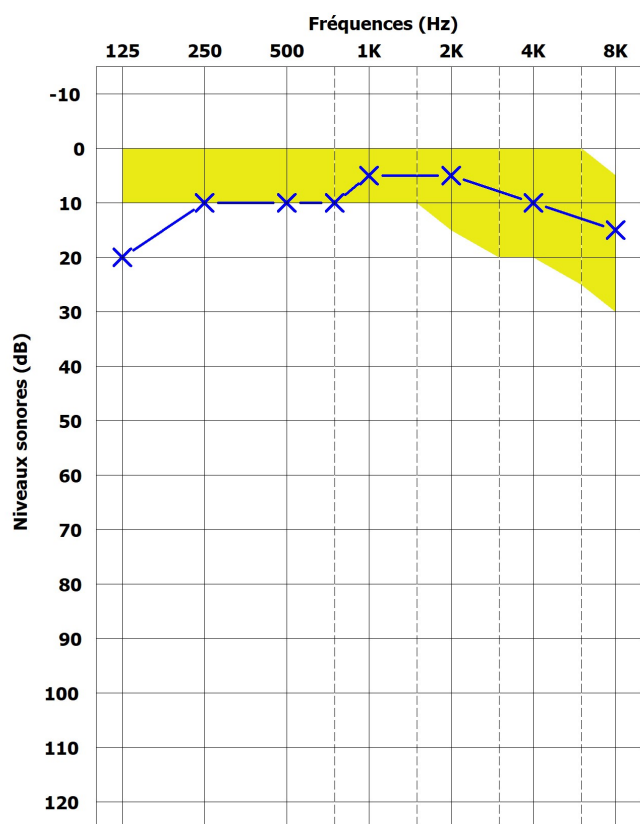

Oreille Gauche

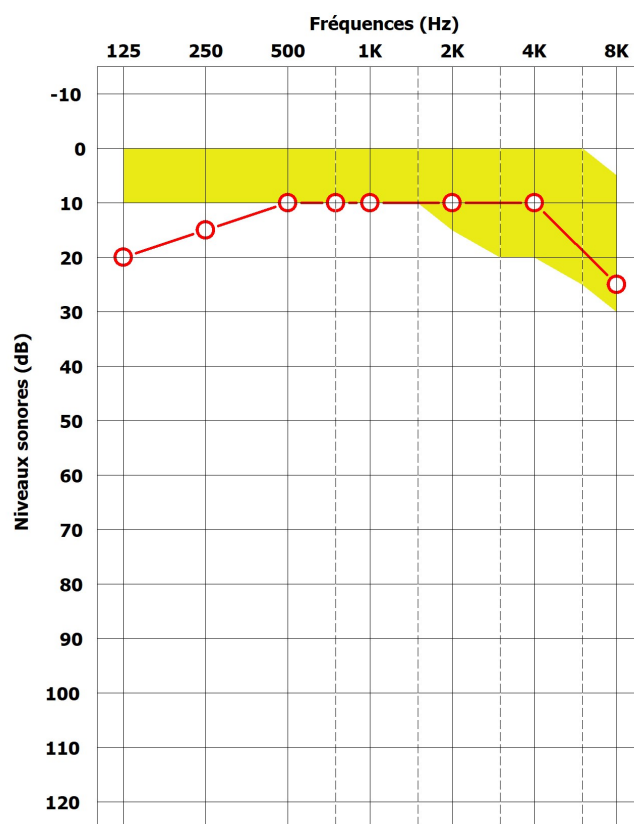

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche | 20  | 10  | 10  | 10  | 5  |     | 5  |    | 10 |    | 15 |
| CA Droit  | 20  | 15  | 10  | 10  | 10 |     | 10 |    | 10 |    | 25 |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 7,5 dB  | --- |
| CA Droit        | 10,0 dB | --- |

Notes