


MEDVIE


Date du test: 27/01/2024 10:49:48
Durée: 4mn 59s
Type test Manuel
Continu

Données Patient	
SOUMAORO MAMADY 2	
Date de naissance	25/05/1983
Age	40
Société	FEG SARL
ID	24012710452619440

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

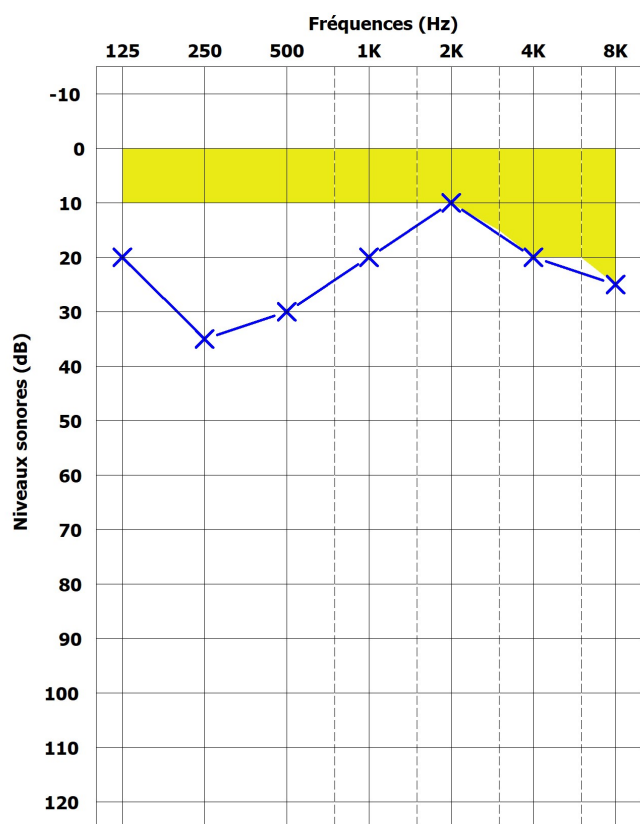

Oreille Gauche

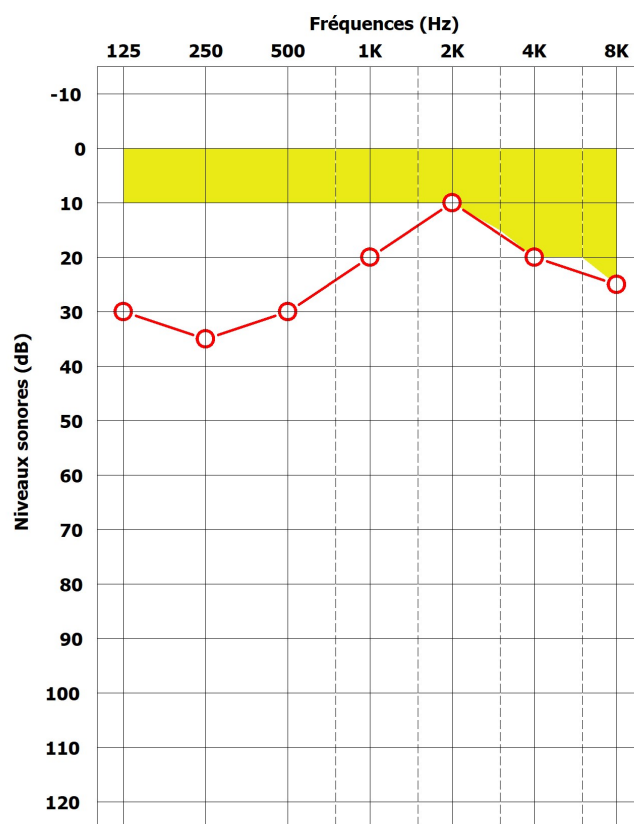

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	35	30		20		10		20		25
CA Droit	30	35	30		20		10		20		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	20,0 dB	---

Notes