


MEDVIE


Date du test: 27/01/2024 09:59:41
Durée: 6mn 26s
Type test Manuel
Continu

Données Patient		CONDE MOHAME
Date de naissance	28/05/1989	
Age	34	
Société	FEG SARL	
ID	24012709562949821	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

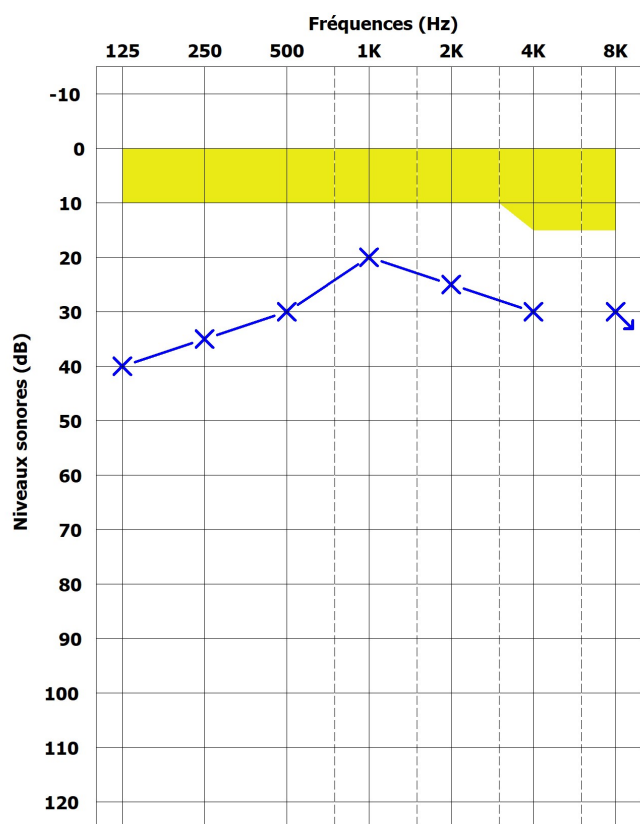

Oreille Gauche

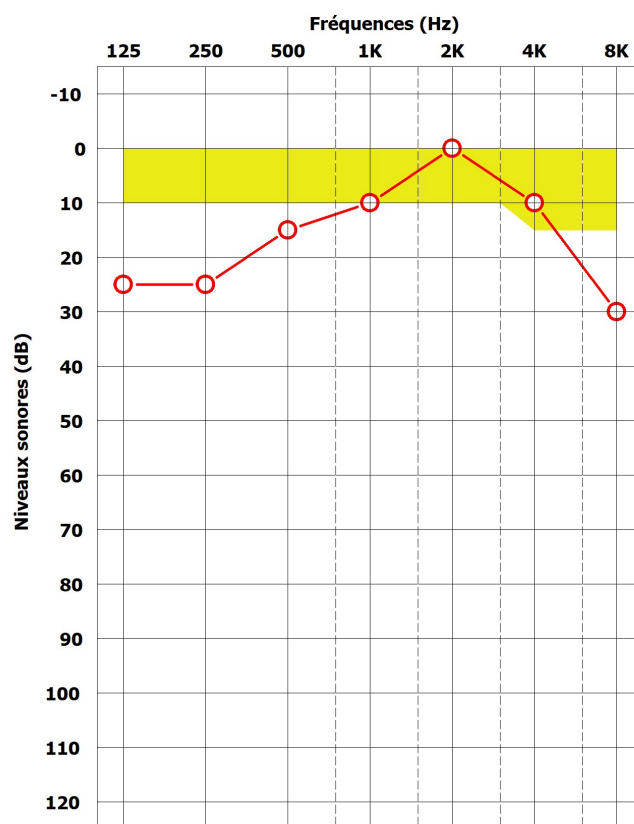

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	40	35	30		20		25		30		(30)
CA Droit	25	25	15		10		0		10		30

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	26,3 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes