


MEDVIE


Date du test: 27/01/2024 11:08:43
Durée: 3mn 54s
Type test Manuel
Continu

Données Patient	
CAMARA IBRAHIMA	
Date de naissance	01/01/1997
Age	27
Société	FEG SARL
ID	24012711060012879

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

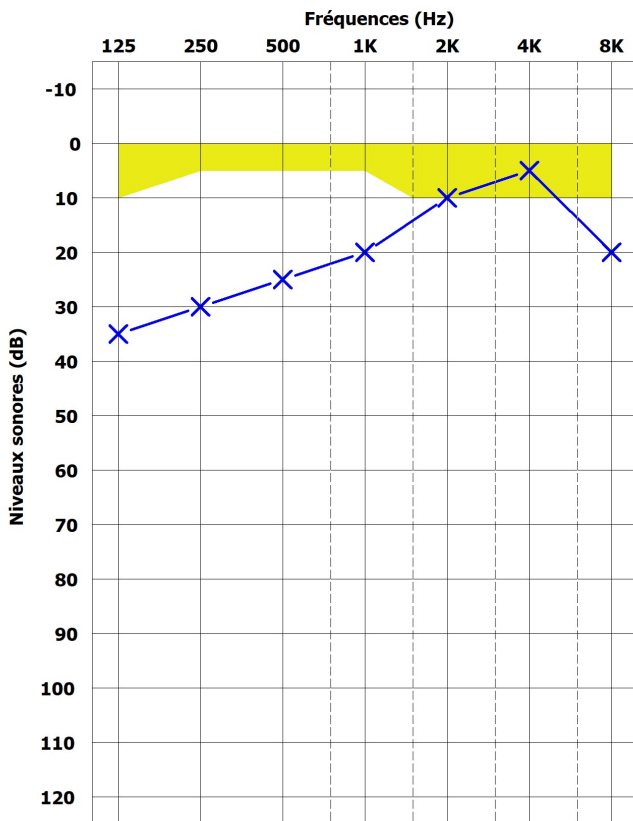

Oreille Gauche

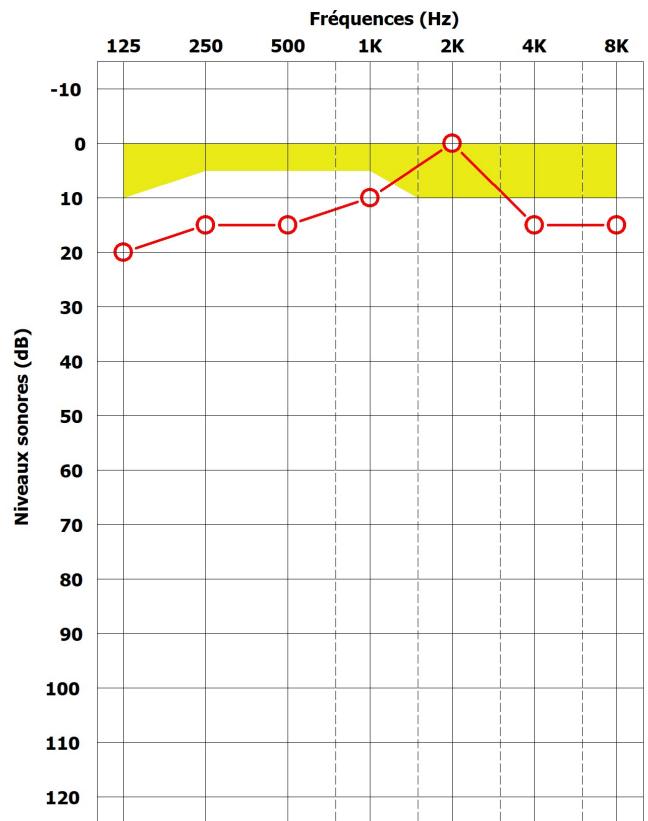

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	35	30	25		20		10		5		20
CA Droit	20	15	15		10		0		15		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	10,0 dB	---

Notes