


MEDVIE


Date du test: 27/01/2024 10:39:45
Durée: 3mn 11s
Type test Manuel
Continu

Données Patient	
CAMARA LANCINE SARAN	
Date de naissance	10/06/1994
Age	29
Société	FEG SARL
ID	24012710365316064

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

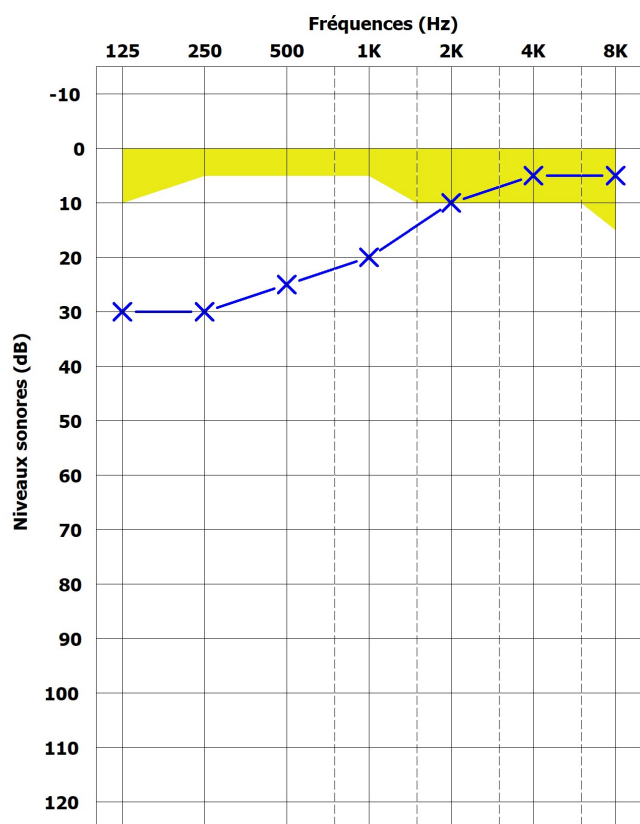

Oreille Gauche

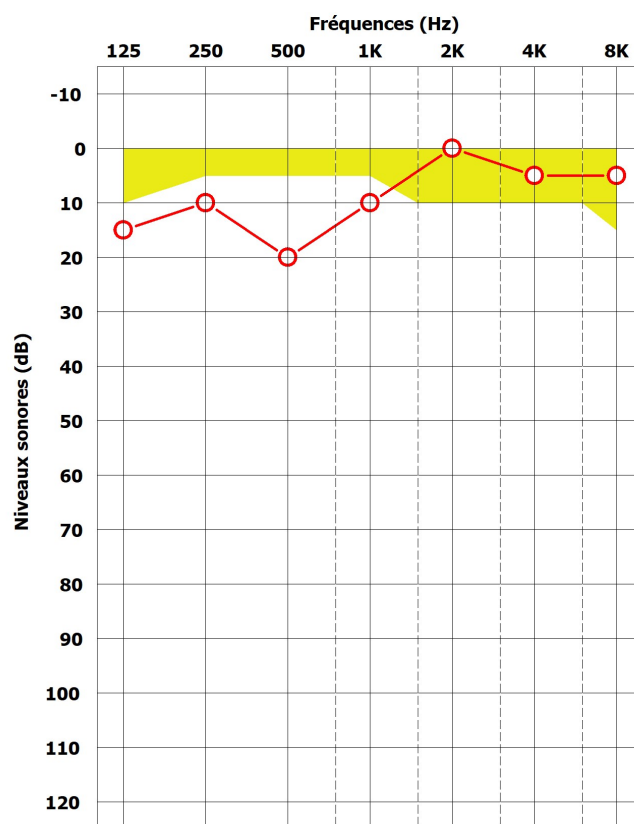

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	30	30	25		20		10		5		5
CA Droit	15	10	20		10		0		5		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes