


MEDVIE


Date du test: 27/01/2024 11:31:38
Durée: 3mn 04s
Type test Manuel
Continu

Données Patient	
CAMARA MOUSSA KEME	
Date de naissance	08/03/1994
Age	29
Société	FEG SARL
ID	24012711295899503

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

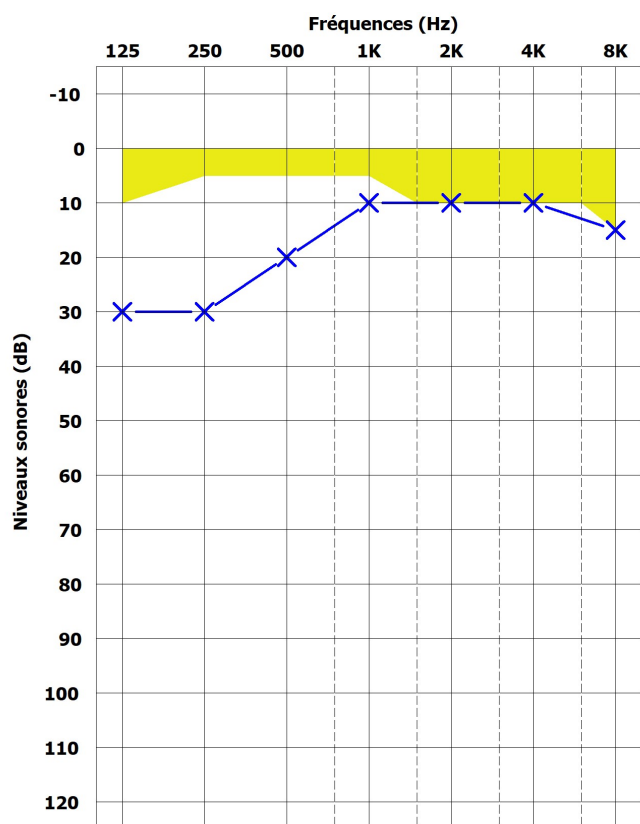

Oreille Gauche

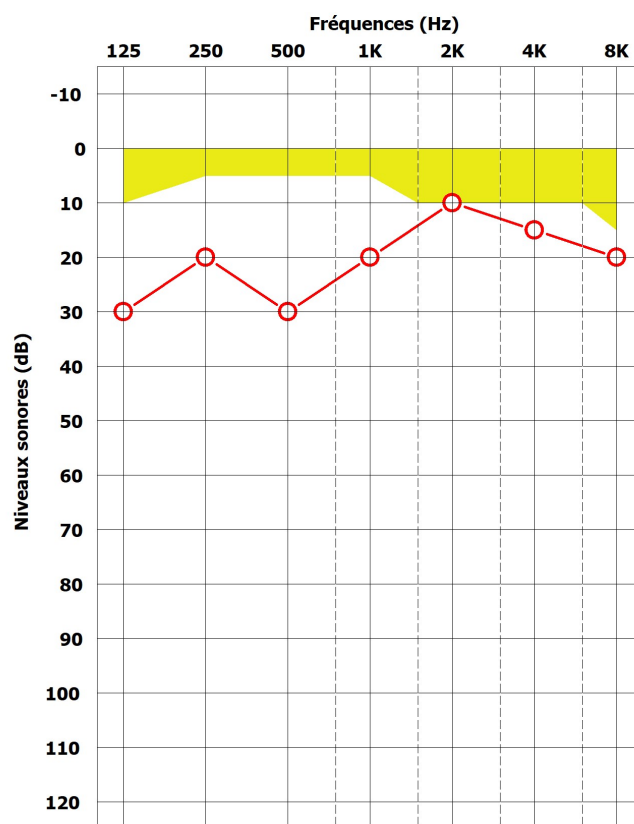

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	30	30	20		10		10		10		15
CA Droit	30	20	30		20		10		15		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes