


MEDVIE


Date du test: 27/01/2024 11:16:53
Durée: 3mn 23s
Type test Manuel
Continu

Données Patient	
BERETE ALASSANE	
Date de naissance	20/03/1996
Age	27
Société	FEG SARL
ID	24012711135602317

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

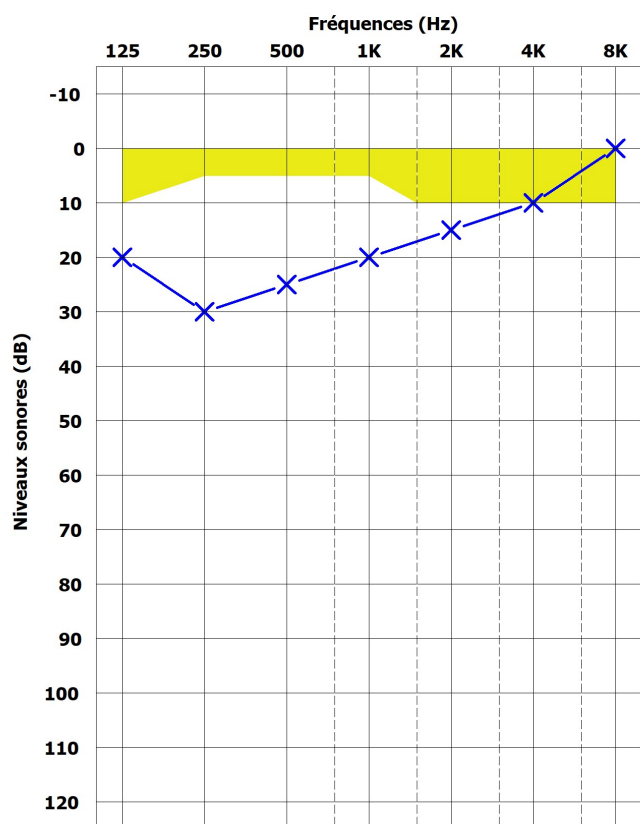

Oreille Gauche

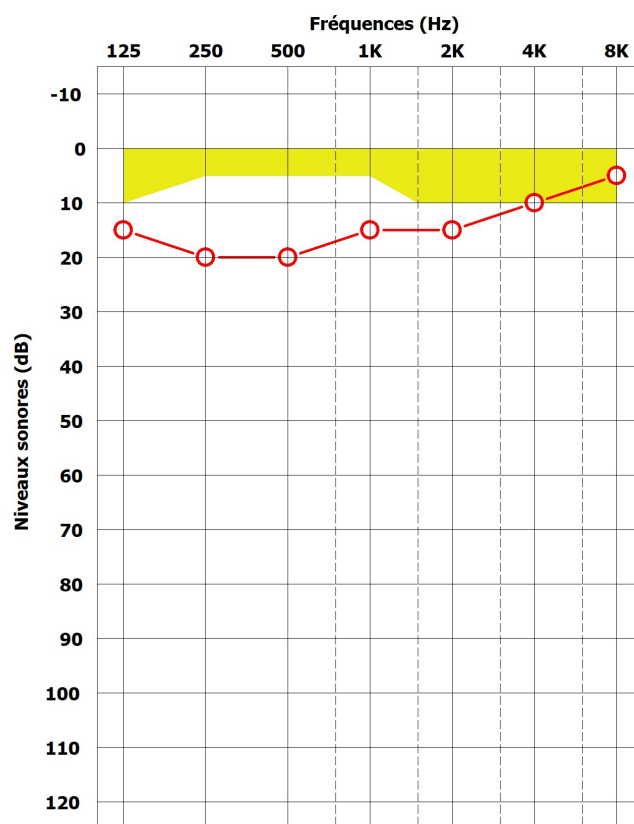

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	30	25		20		15		10		0
CA Droit	15	20	20		15		15		10		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes