


MEDVIE


Date du test: 27/01/2024 09:47:15
Durée: 5mn 29s
Type test Manuel
Continu

Données Patient	KANTE KABA
Date de naissance	01/01/1986
Age	38
Société	FEG SARL
ID	24012709423970543

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

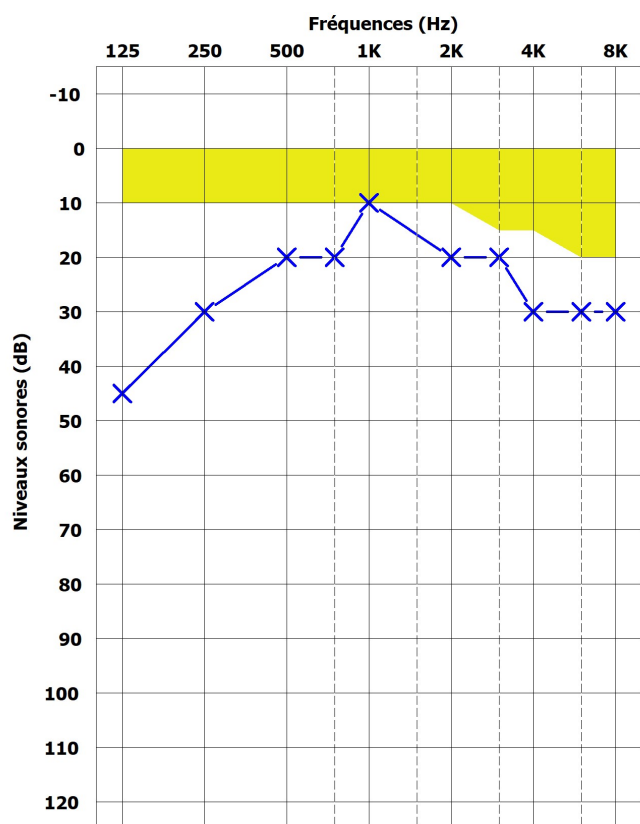

Oreille Gauche

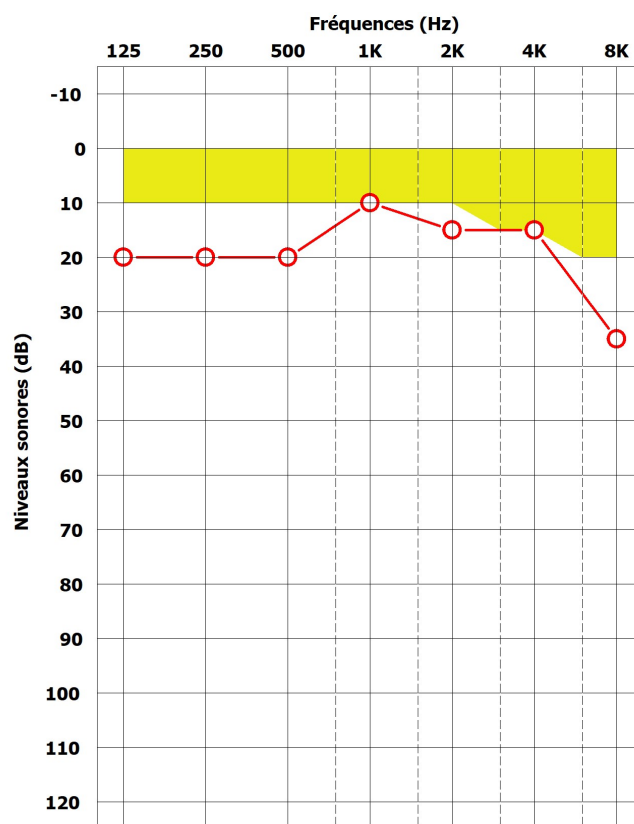

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	45	30	20	20	10		20	20	30	30	30
CA Droit	20	20	20		10		15		15		35

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	26,7 dB
CA Droit	15,0 dB	---

Notes