


MEDVIE


Date du test: 24/07/2025 13:22:18
Durée: 5mn 13s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CHERIF MOUSSA	
Date de naissance	13/11/1995
Age	29
Société	FEG SARL
ID	25072413021874046

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

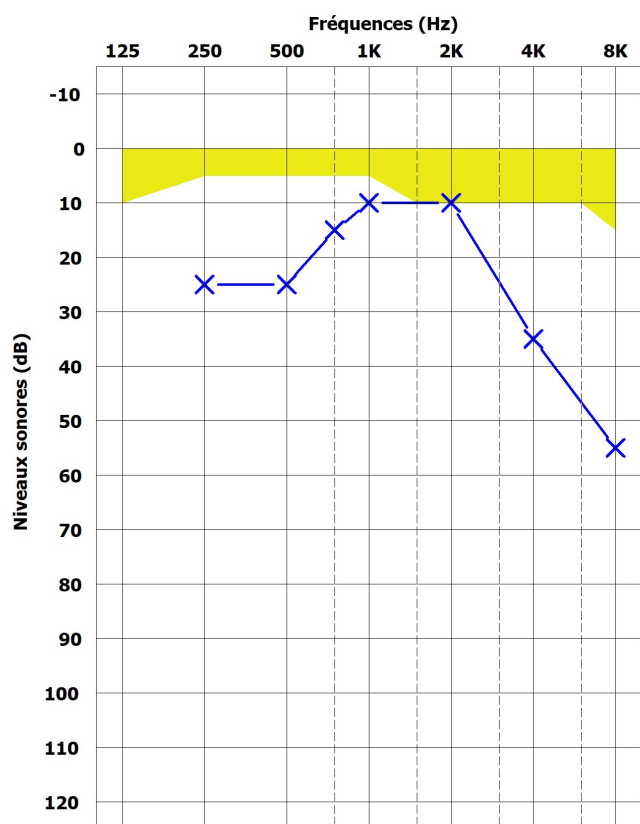

Oreille Gauche

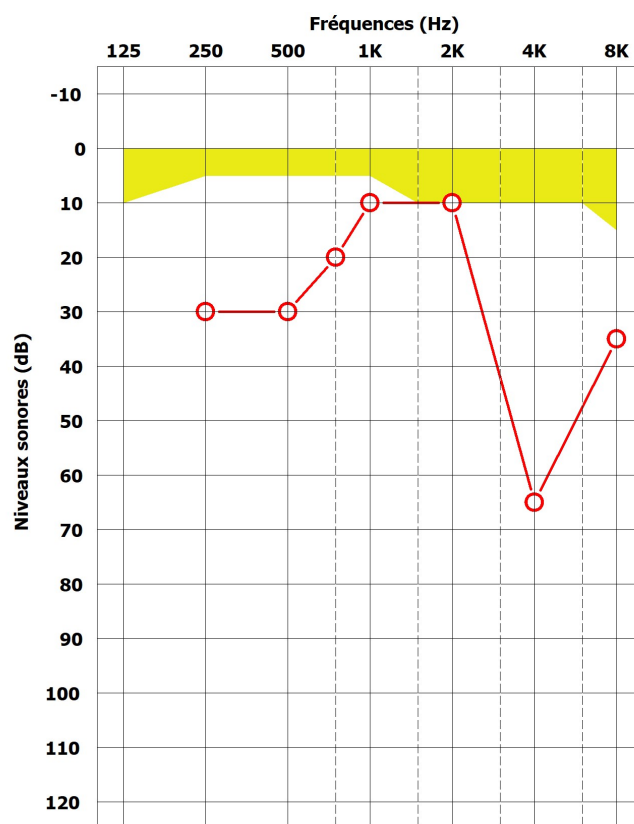

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25	15	10		10		35		55
CA Droit		30	30	20	10		10		65		35

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	28,8 dB	---

Notes