


MEDVIE


Date du test: 27/01/2024 10:31:16
Durée: 4mn 23s
Type test Manuel
Continu

Données Patient		SOW SAMBA
Date de naissance	19/04/1994	
Age	29	
Société	FEG SARL	
ID	24012710290121359	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

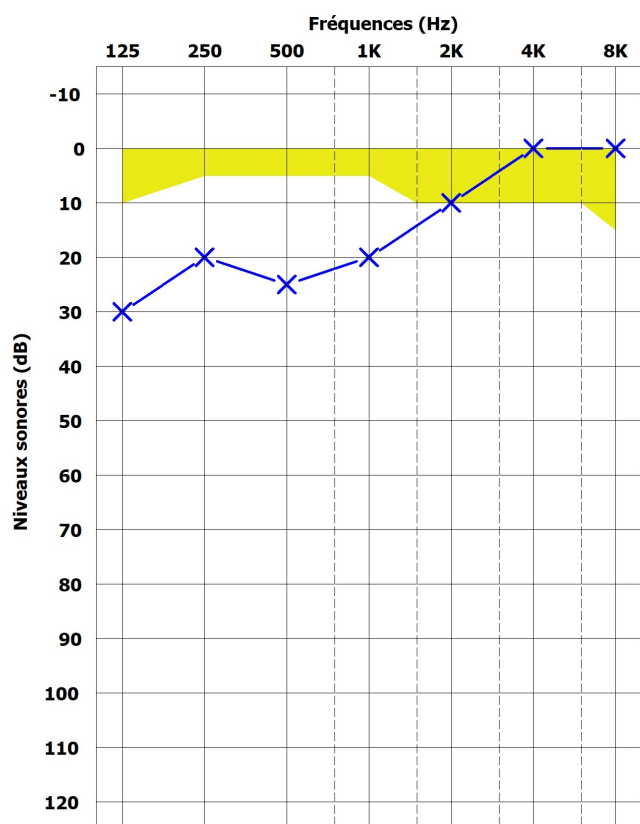

Oreille Gauche

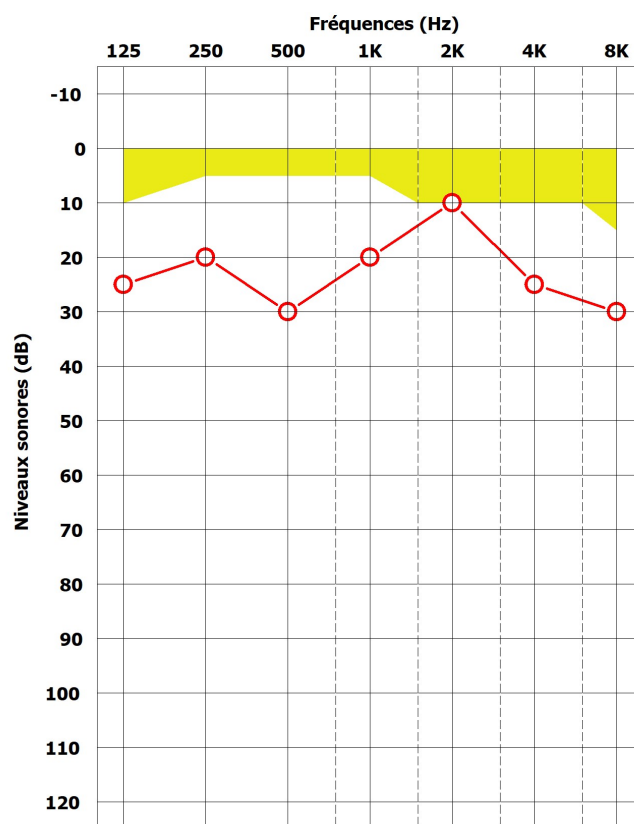

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	30	20	25		20		10		0		0
CA Droit	25	20	30		20		10		25		30

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	21,3 dB	---

Notes