


MEDVIE


Date du test: 27/01/2024 11:24:52
Durée: 2mn 50s
Type test Manuel
Continu

Données Patient	
KONE FALYKOU MAFATA	
Date de naissance	01/01/1990
Age	34
Société	FEG SARL
ID	24012711211796217

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

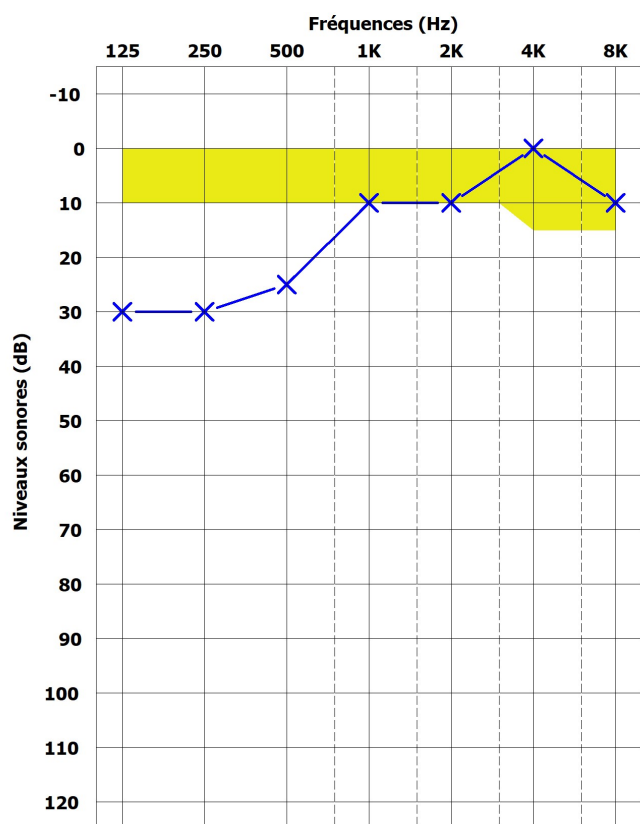

Oreille Gauche

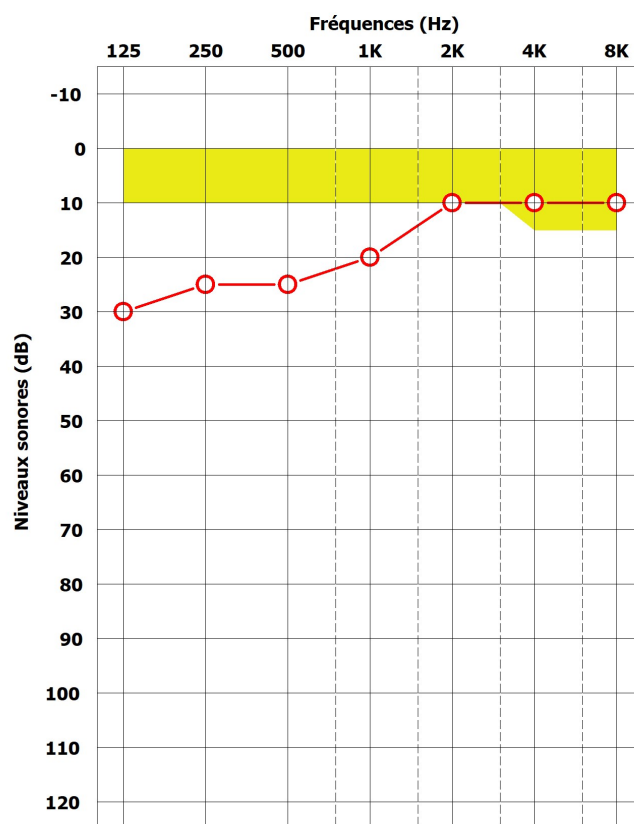

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	30	30	25		10		10		0		10
CA Droit	30	25	25		20		10		10		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes