


MEDVIE


Date du test: 27/01/2024 09:33:50
Durée: 3mn 52s
Type test Manuel
Continu

Données Patient	
FOFANA MARIAMA	
Date de naissance	11/04/1997
Age	26
Société	FEG SARL
ID	24012709300722298

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

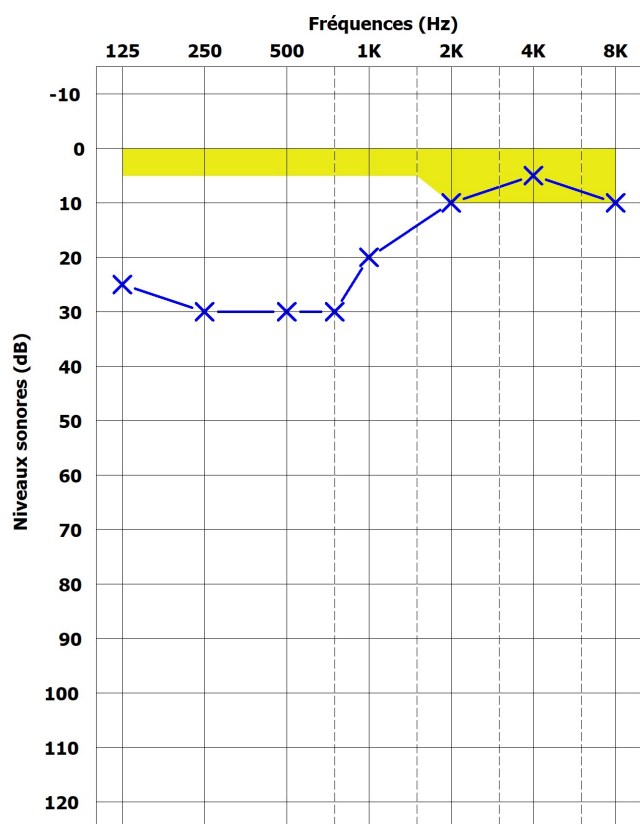

Oreille Gauche

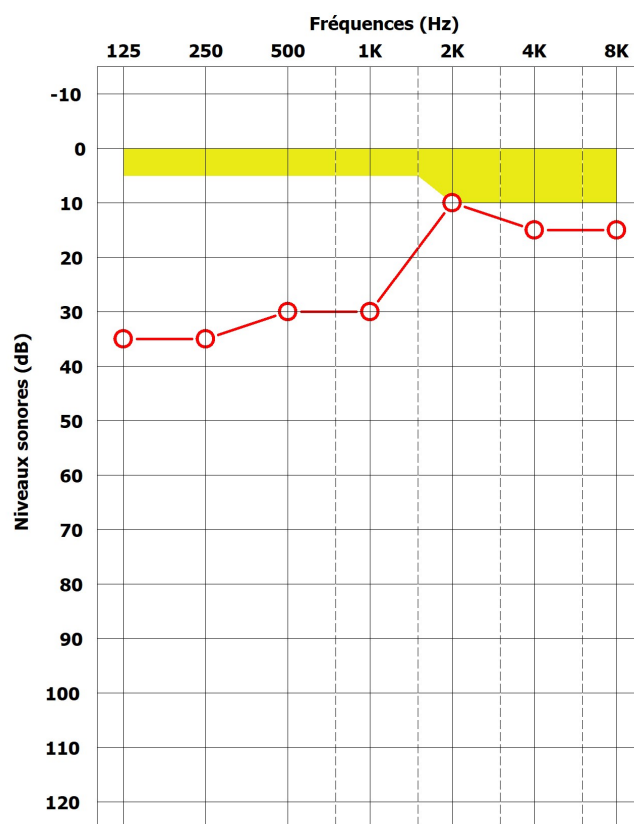

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	30	30	30	20		10		5		10
CA Droit	35	35	30		30		10		15		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	21,3 dB	---

Notes