


MEDVIE


Date du test: 11/03/2024 12:51:19
Durée: 5mn 54s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
SAGNO SEKOU	
Date de naissance	01/01/1974
Age	50
Société	CHICO
ID	24031112480560136

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

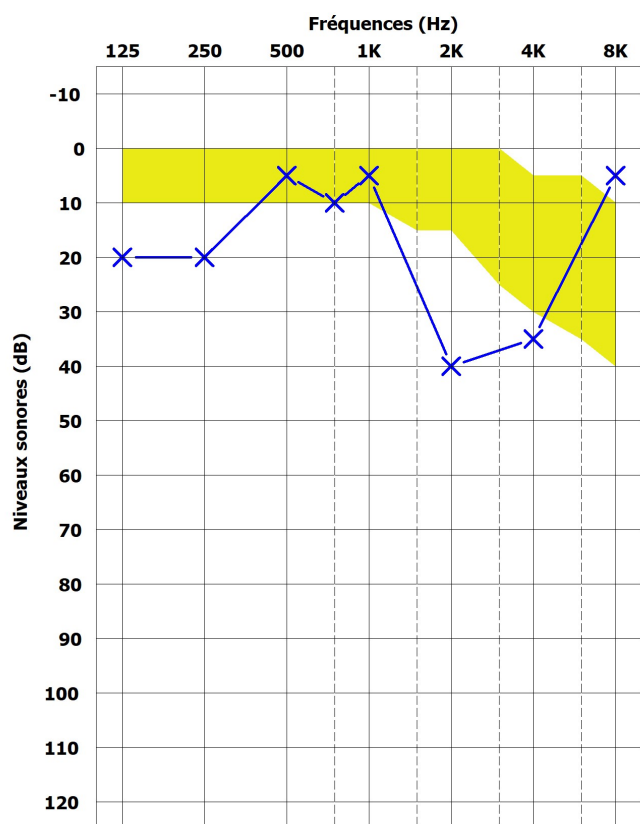

Oreille Gauche

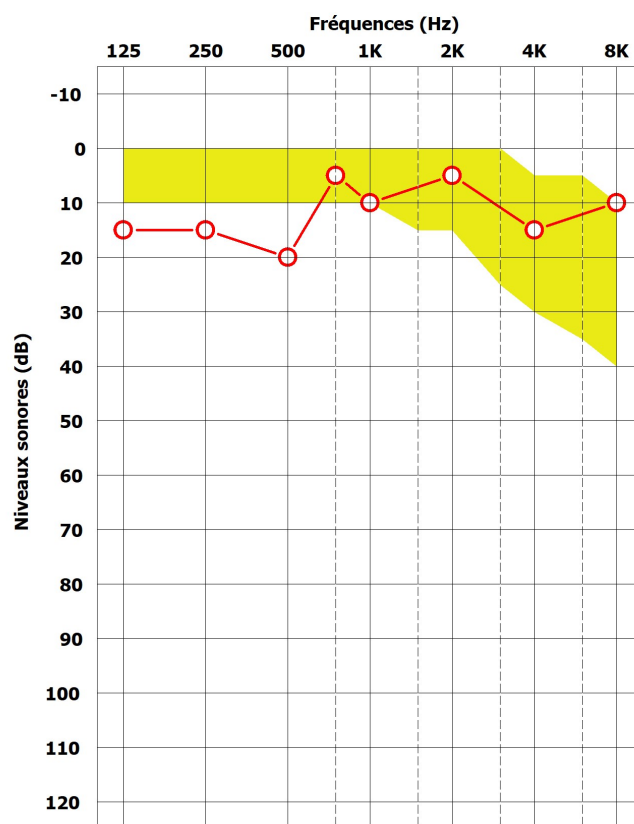

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	20	5	10	5		40		35		5
CA Droit	15	15	20	5	10		5		15		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	21,3 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes