


MEDVIE


Date du test: 30/01/2024 15:01:43

Durée: 6mn 17s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

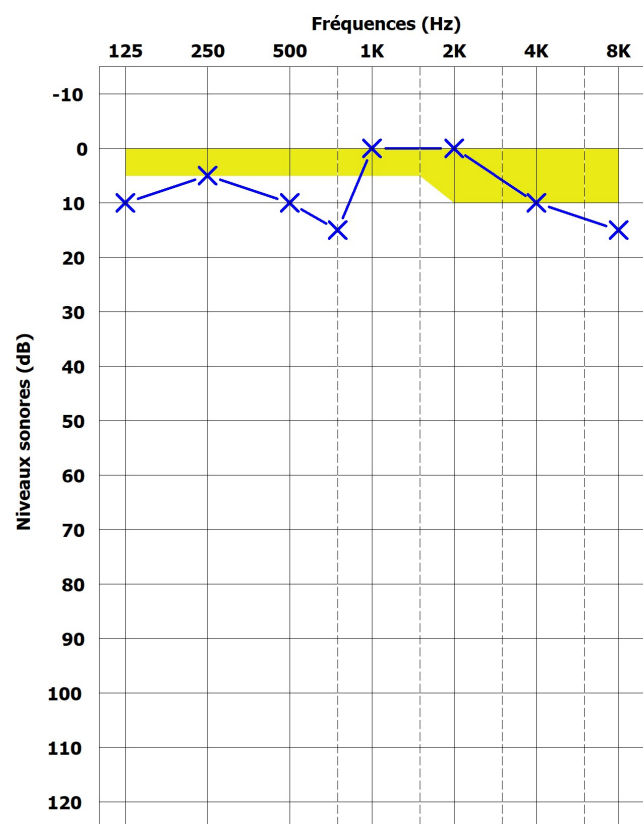

Oreille Gauche

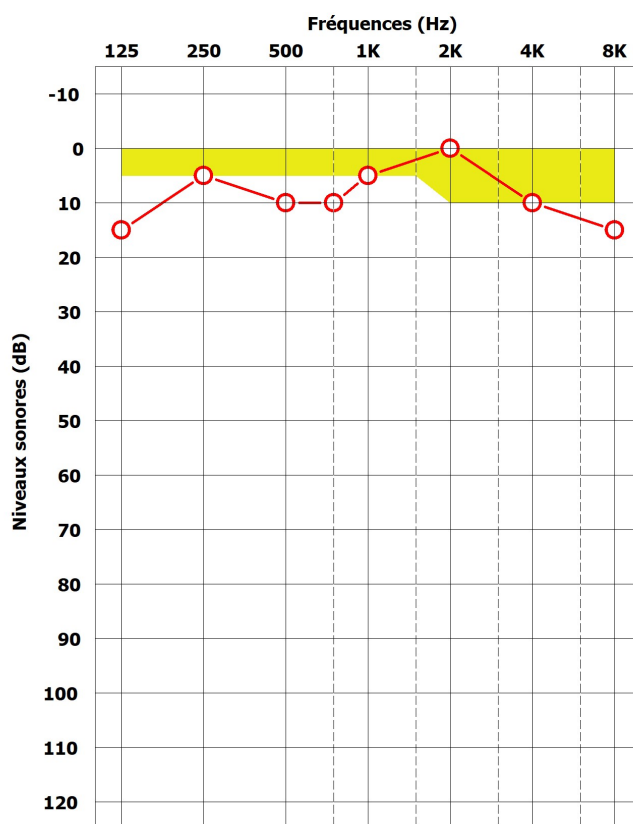

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	10	5	10	15	0		0		10		15
CA Droit	15	5	10	10	5		0		10		15

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	5,0 dB	---
CA Droit	6,3 dB	---

Notes

Données Patient	SOUMAORO SEKOU
Date de naissance	01/01/2002
Age	22
Société	CHICO
ID	24013014582154216

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021