

MEDVIE


Date du test: 22/02/2024 08:58:29

Durée: 8mn 18s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KOUROUMA BANGALY	
Date de naissance	01/01/1999
Age	25
Société	COVEC
ID	24022208560850829

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

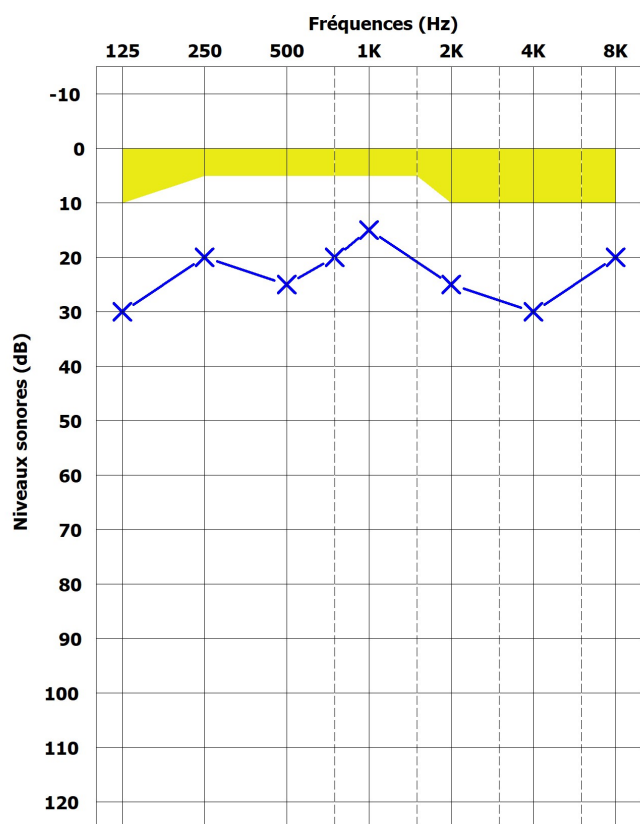

Oreille Gauche

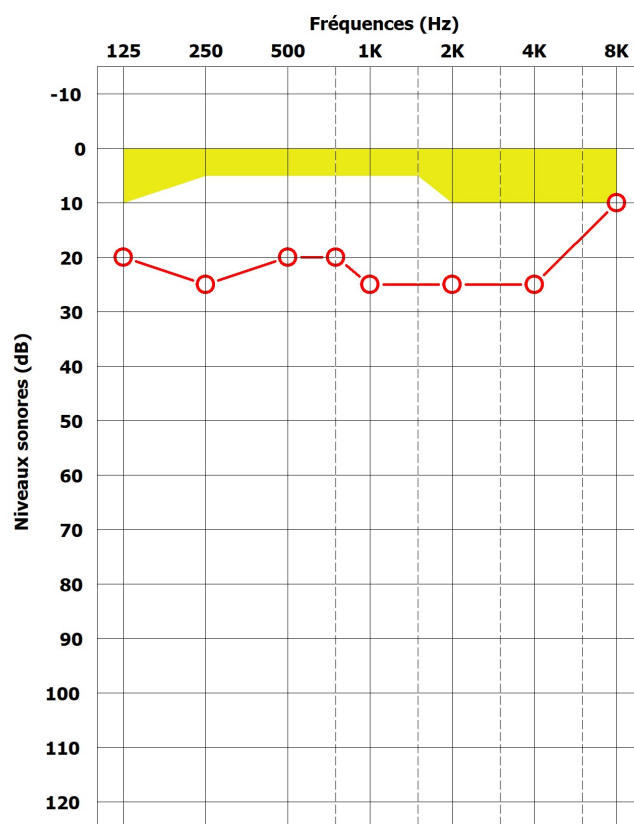

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	30	20	25	20	15		25		30		20
CA Droit	20	25	20	20	25		25		25		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	23,8 dB	---
CA Droit	23,8 dB	---

Notes