

MEDVIE


Date du test: 20/02/2024 09:44:32

Durée: 5mn 37s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	CAMARA MOHAMED
Date de naissance	01/01/1990
Age	34
Société	COVEC
ID	24022009425178092

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

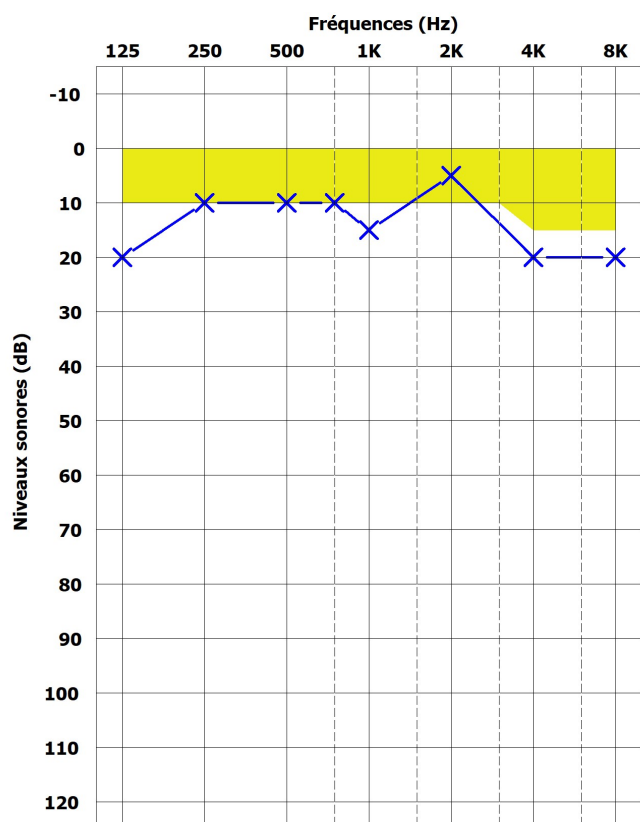

Oreille Gauche

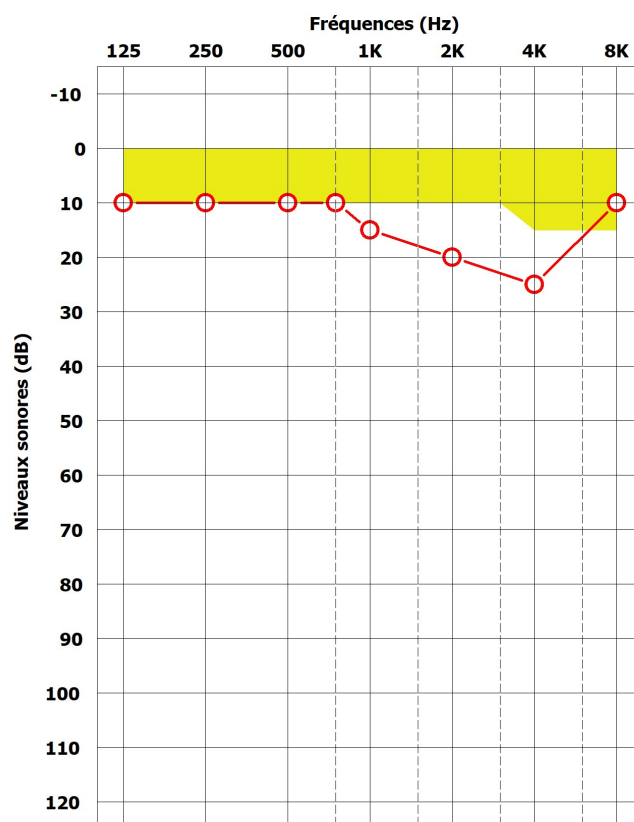

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	10	10	10	15		5		20		20
CA Droit	10	10	10	10	15		20		25		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes