


MEDVIE


Date du test: 26/04/2024 13:07:47

Durée: 7mn 34s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

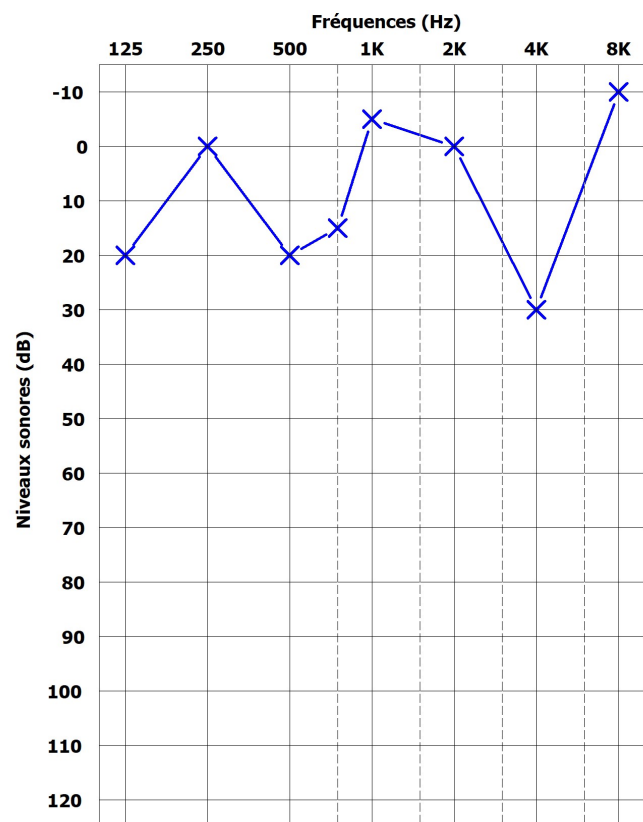

Oreille Gauche

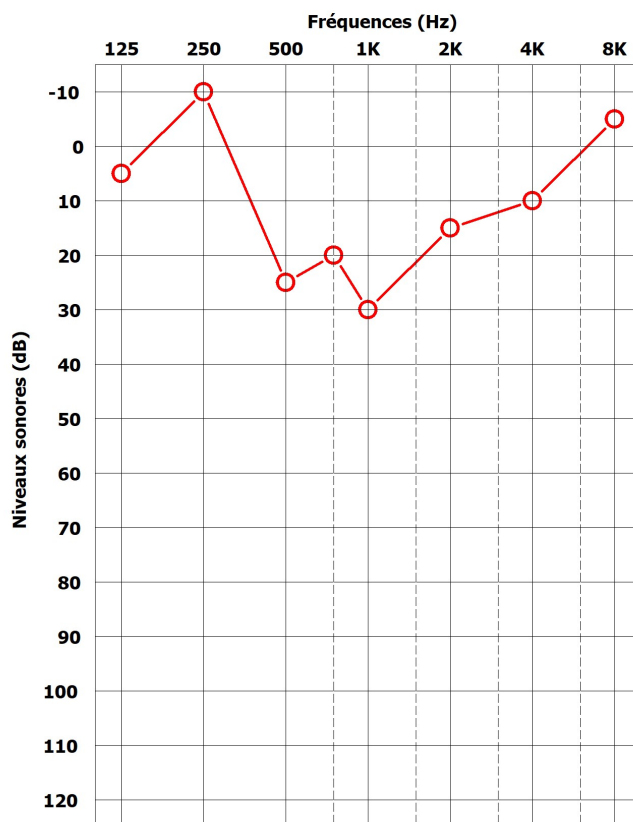

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	0	20	15	-5		0		30		-10
CA Droit	5	-10	25	20	30		15		10		-5

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	20,0 dB	---

Notes

Données Patient

SAGNO MOUSSA

Date de naissance

22/09/1972

Age

51

Société

COVEC

ID

24042612512667277

Audiomètre

Type:

Audio 820M V2,211

Numéro de série:

2111EAT690093

Date Calibration :

30/11/2021