

MEDVIE

Date du test: 24/02/2024 13:02:19

Durée: 6mn 06s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient

GNOMI REMON

Date de naissance 03/05/1996

Age 27

Société COVEC


ID 24022412594114688

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690093

Date Calibration : 30/11/2021

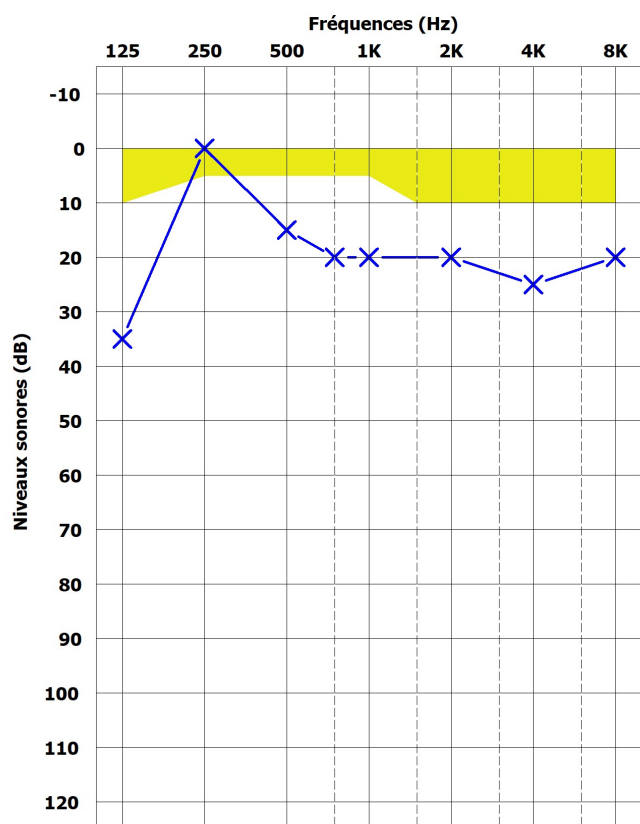

Oreille Gauche

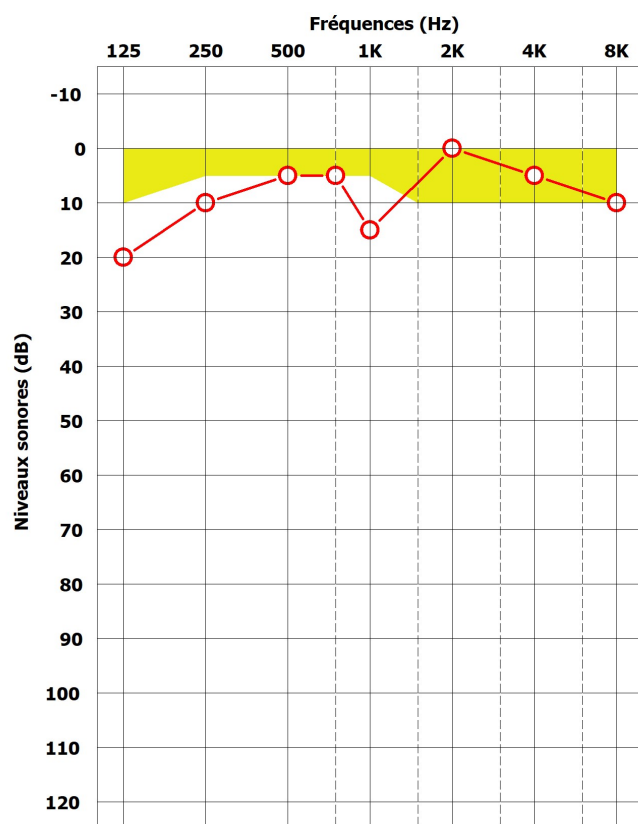

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	35	0	15	20	20		20		25		20
CA Droit	20	10	5	5	15		0		5		10

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	6,3 dB	---

Notes