


MEDVIE


Date du test: 20/02/2024 16:01:41
Durée: 5mn 28s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
SAGNO MAMADI	
Date de naissance	10/09/1980
Age	43
Société	COVEC
ID	24022015562610228

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

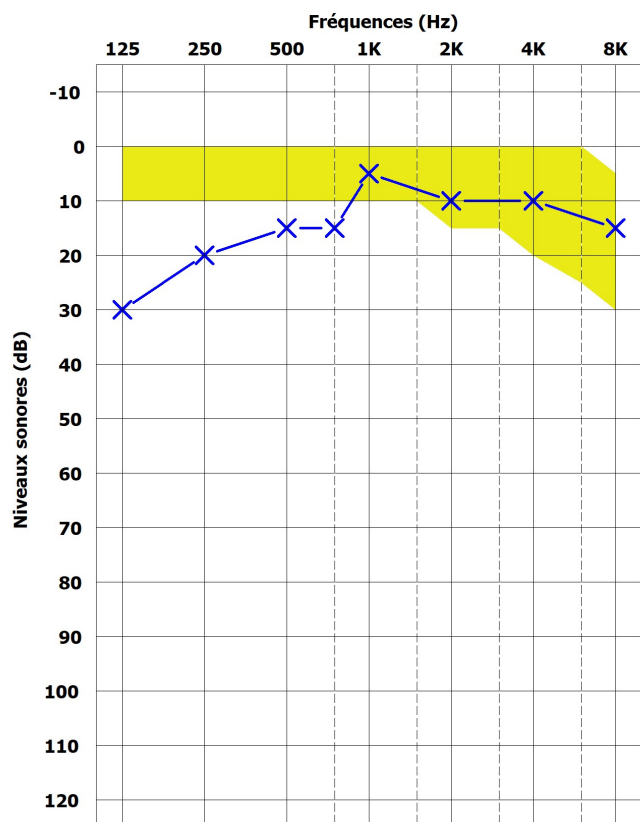

Oreille Gauche

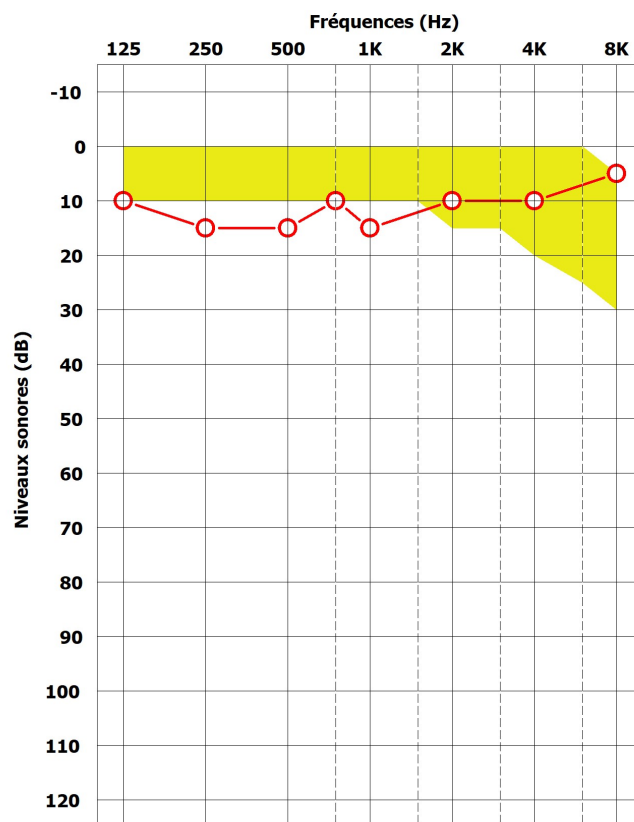

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	30	20	15	15	5		10		10		15
CA Droit	10	15	15	10	15		10		10		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes