


MEDVIE


Date du test: 19/02/2024 15:43:22

Durée: 6mn 04s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

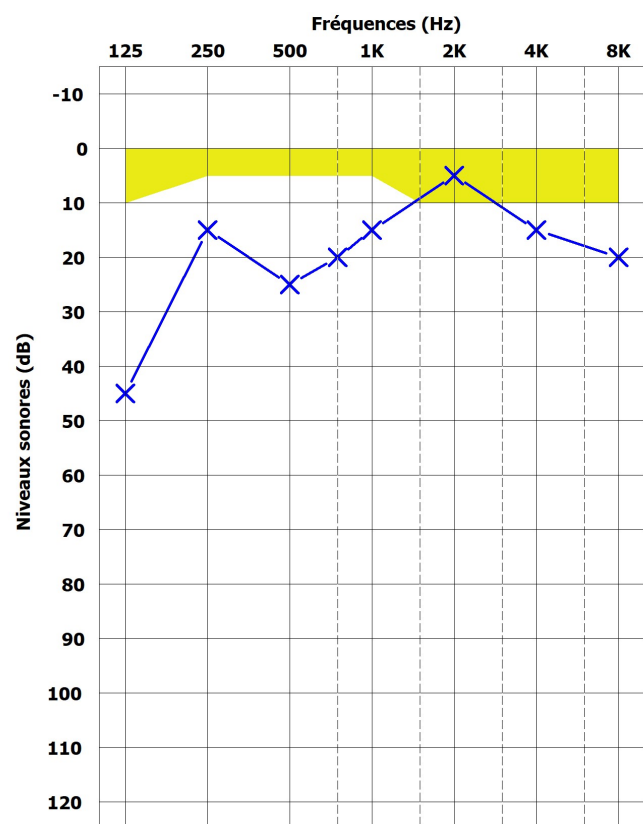

Oreille Gauche

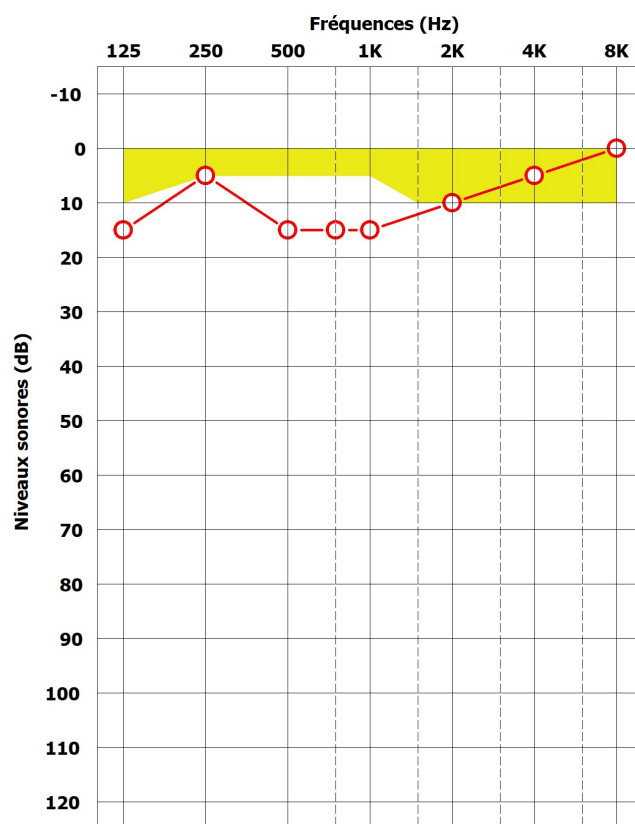

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	45	15	25	20	15		5		15		20
CA Droit	15	5	15	15	15		10		5		0

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes

Données Patient

SIDIBE SALA

Date de naissance

01/01/1997

Age

27

Société

COVEC

ID

24021915410782779

Audiomètre

Type:

Audio 820M V2,211

Numéro de série:

2111EAT690093

Date Calibration :

30/11/2021