


MEDVIE


Date du test: 21/09/2024 12:15:49
Durée: 5mn 14s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
BILIVOGUI EDOUARD	
Date de naissance	10/11/2000
Age	23
Société	COVEC
ID	24092112133166483

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

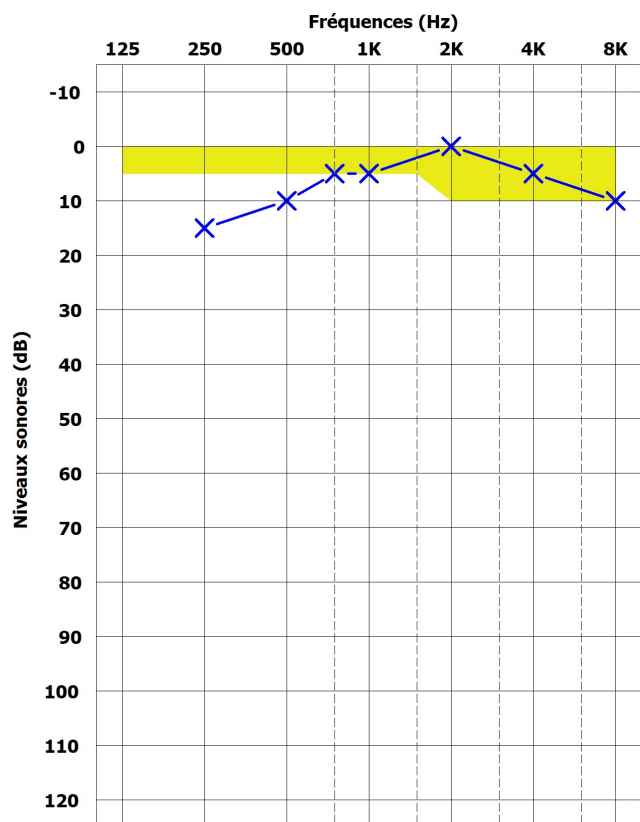

Oreille Gauche

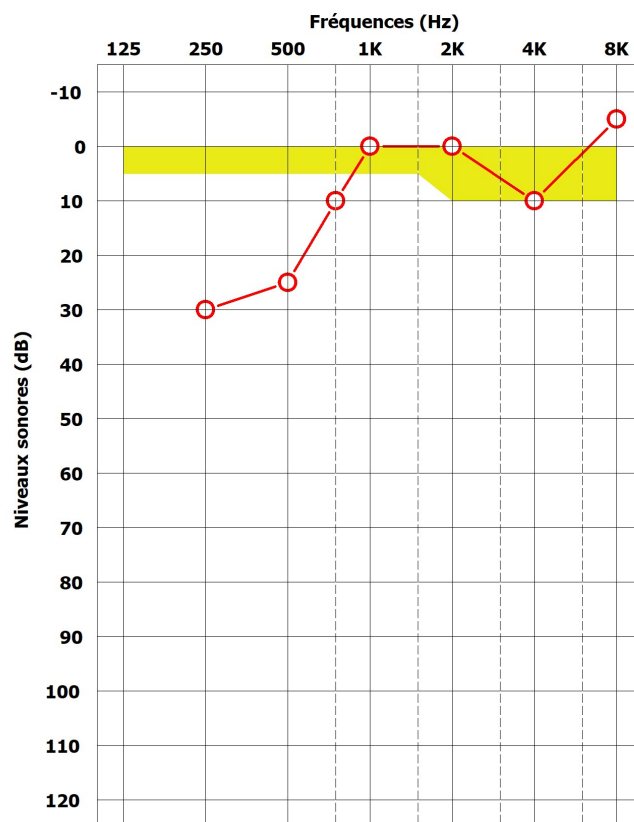

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	10	5	5		0		5		10
CA Droit		30	25	10	0		0		10		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	5,0 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes