

MEDVIE


Date du test: 22/02/2024 11:18:04

Durée: 8mn 03s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		YEAMOU CECE
Date de naissance	01/01/1965	
Age	59	
Société	COVEC	
ID	24022211154117150	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

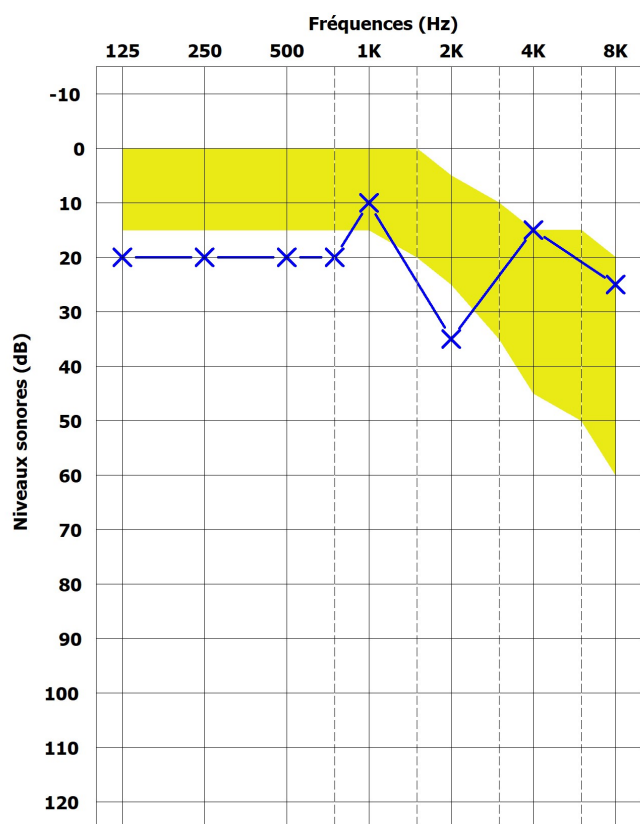

Oreille Gauche

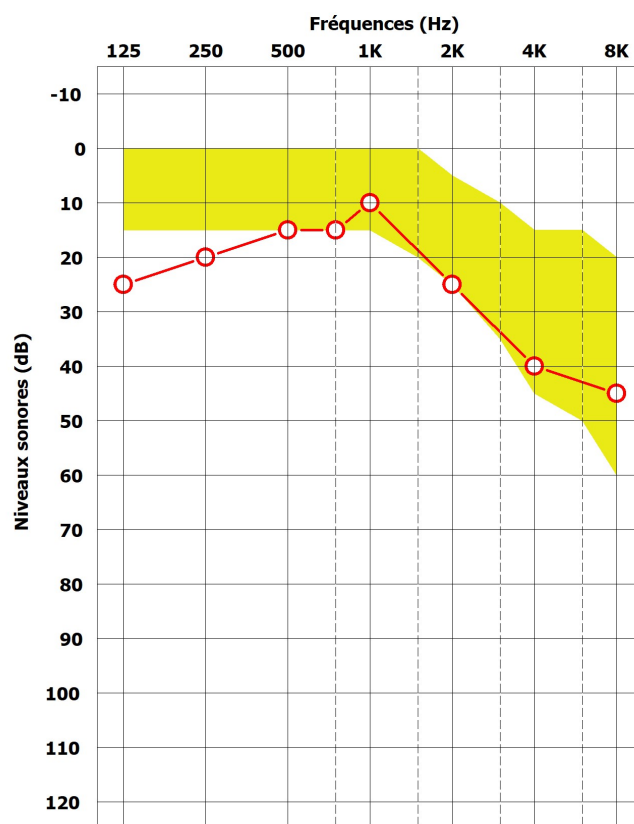

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	20	20	20	10		35		15		25
CA Droit	25	20	15	15	10		25		40		45

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	22,5 dB	---

Notes