

MEDVIE


Date du test: 22/02/2024 13:18:04

Durée: 6mn 29s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KOUROUMA SEKOU	
Date de naissance	01/01/1998
Age	26
Société	COVEC
ID	24022213144841244

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

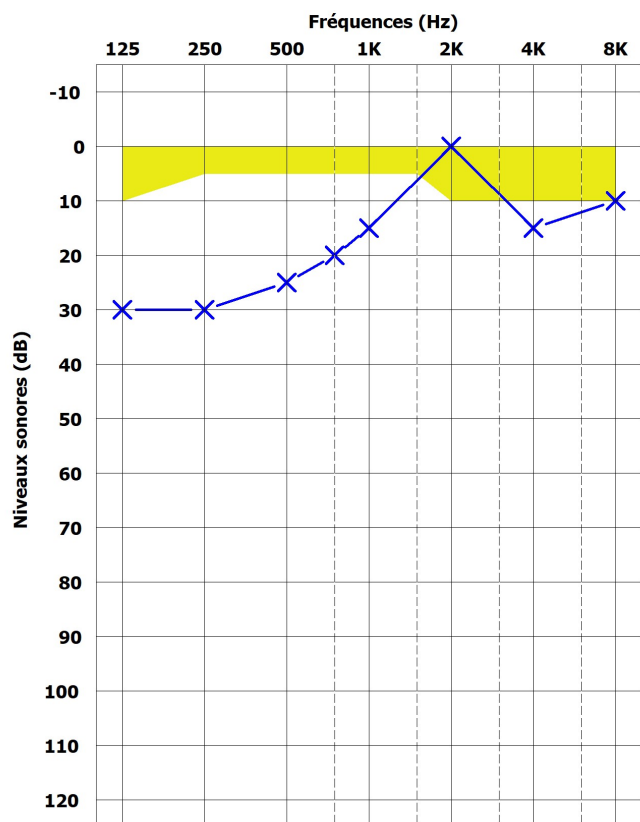

Oreille Gauche

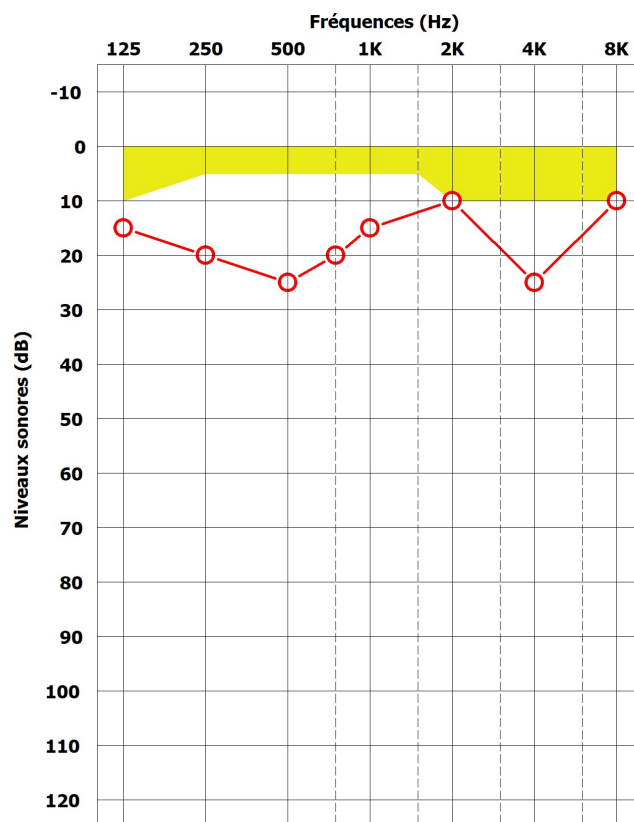

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	30	30	25	20	15		0		15		10
CA Droit	15	20	25	20	15		10		25		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes