


MEDVIE


Date du test: 19/02/2024 15:08:58
Durée: 9mn 32s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KOUROUMA FALIKOU	
Date de naissance	01/01/1984
Age	40
Société	COVEC
ID	24021915064682903

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

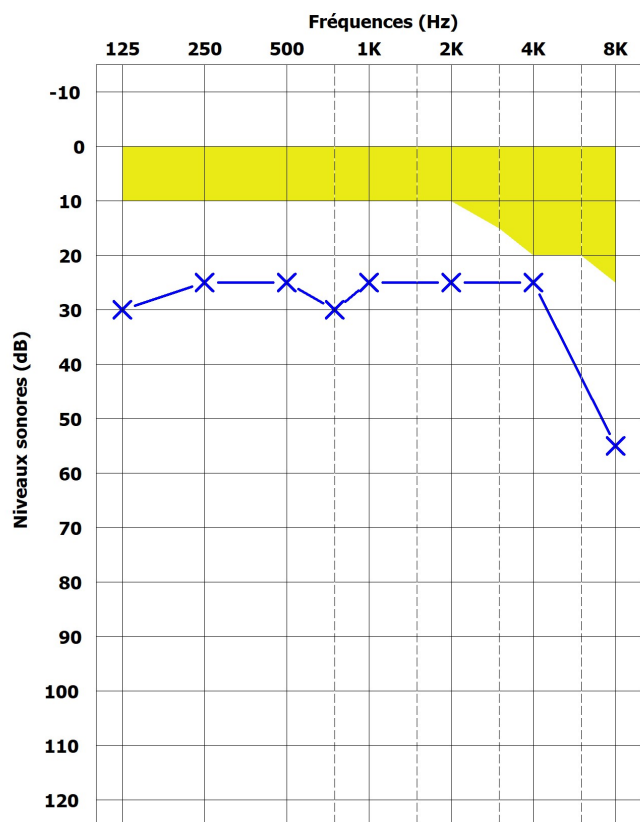

Oreille Gauche

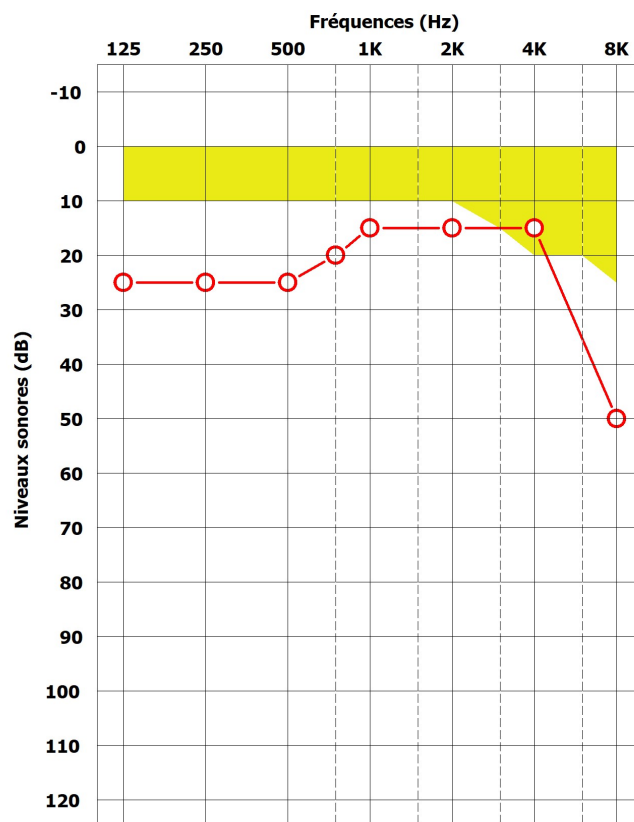

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	30	25	25	30	25		25		25		55
CA Droit	25	25	25	20	15		15		15		50

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	25,0 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes