


MEDVIE


Date du test: 24/02/2024 09:29:49
Durée: 7mn 02s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
SAGNO AGNES	
Date de naissance	01/01/1995
Age	29
Société	COVEC
ID	24022409245440819

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

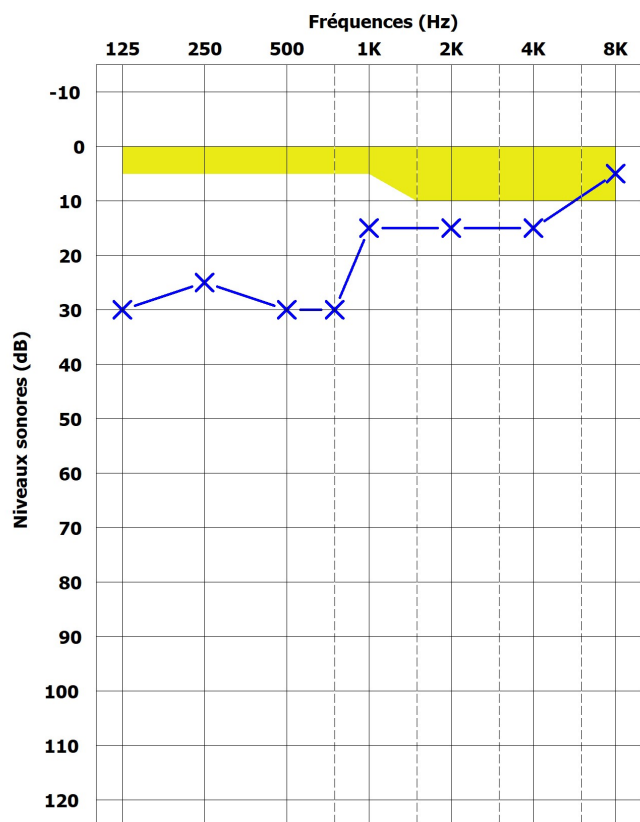

Oreille Gauche

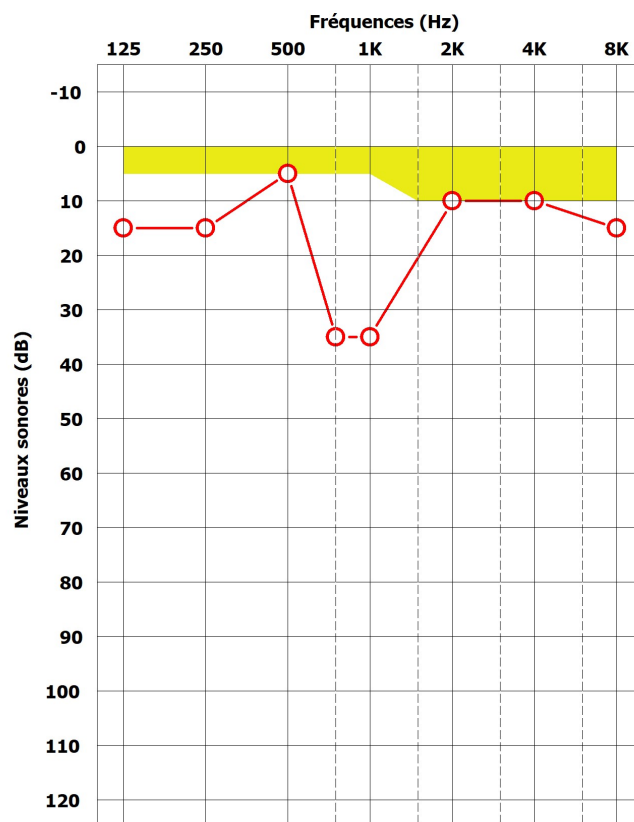

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	30	25	30	30	15		15		15		5
CA Droit	15	15	5	35	35		10		10		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes