

MEDVIE


Date du test: 19/09/2024 11:44:10

Durée: 2mn 25s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		CAMARA OUSMANE
Date de naissance	01/01/1964	
Age	60	
Société	COVEC	
ID	24091911215765591	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

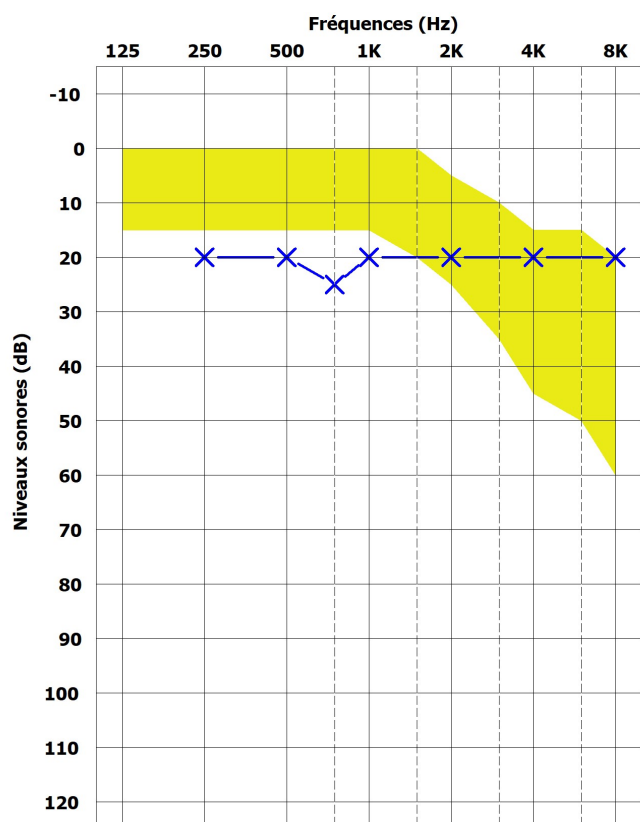

Oreille Gauche

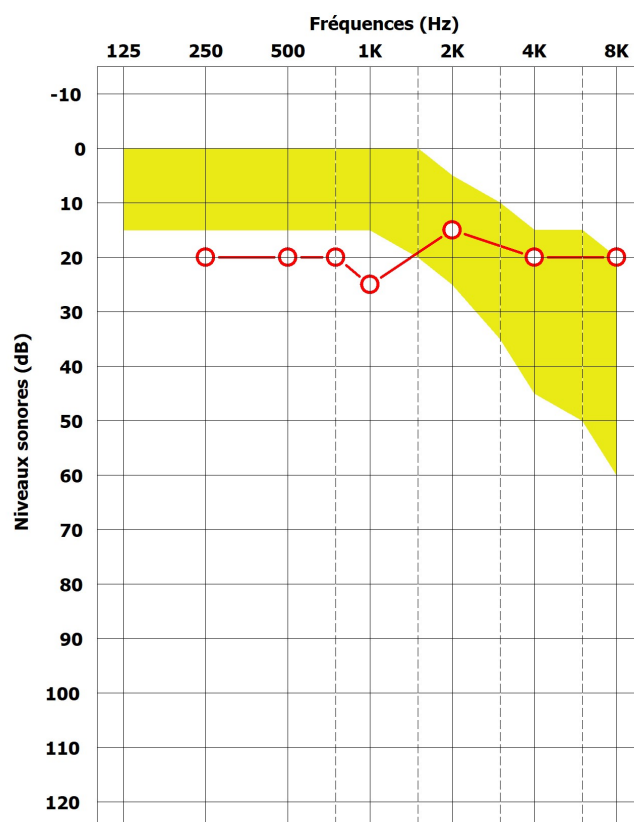

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	20	25	20		20		20		20
CA Droit		20	20	20	25		15		20		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	20,0 dB	---

Notes