

MEDVIE

Date du test: 19/02/2024 11:02:48

Durée: 11mn 03s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient

KANTE IBRAHIMA

Date de naissance 25/10/1993

Age 30

Société COVEC


ID 24021910590958771

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690093

Date Calibration : 30/11/2021

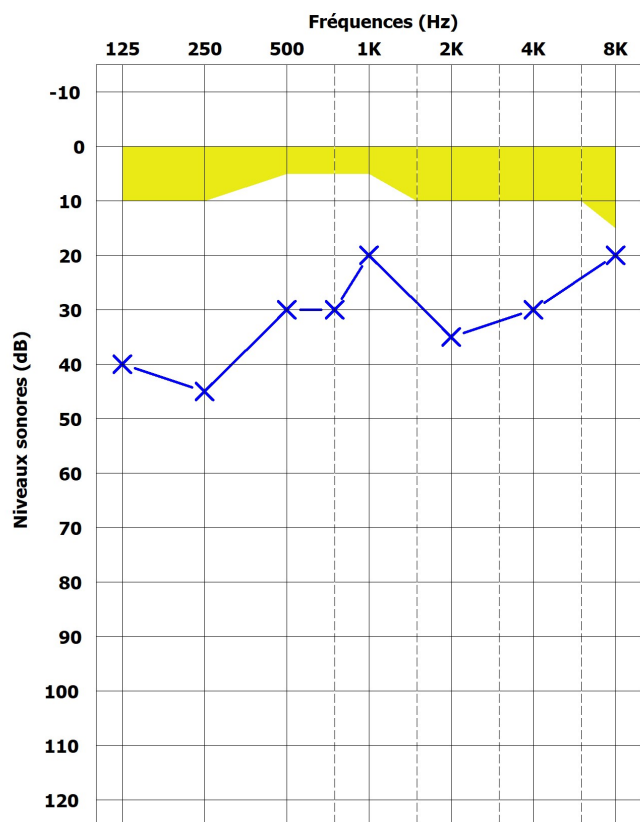

Oreille Gauche

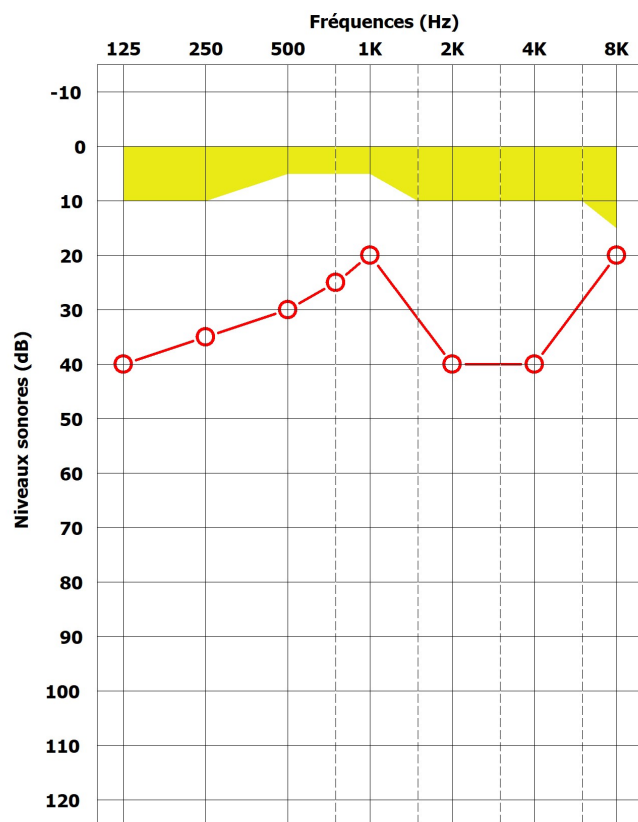

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	40	45	30	30	20		35		30		20
CA Droit	40	35	30	25	20		40		40		20

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	28,8 dB	---
CA Droit	32,5 dB	---

Notes