


MEDVIE


Date du test: 05/10/2024 12:33:52
Durée: 2mn 08s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KOMARA MOUSSA	
Date de naissance	04/04/1986
Age	38
Société	COVEC
ID	24100512233615914

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

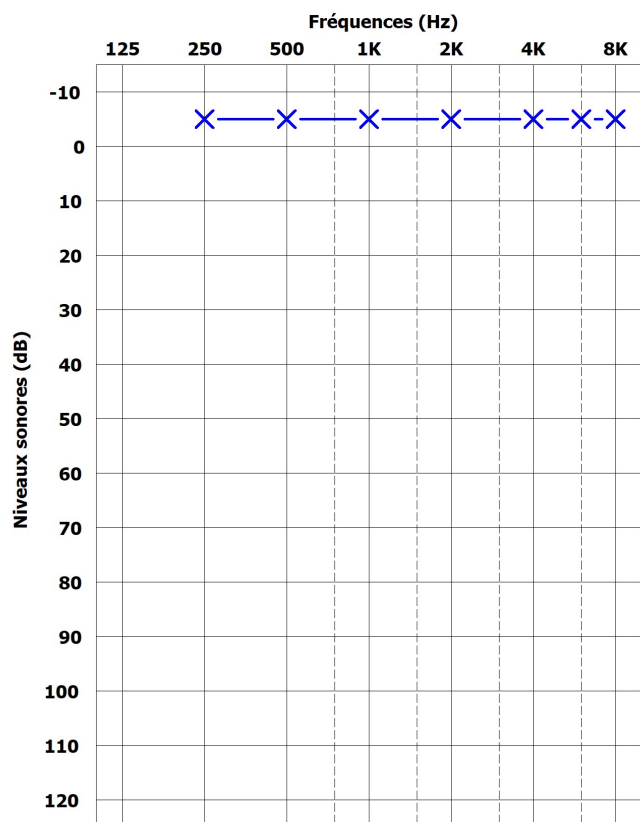

Oreille Gauche

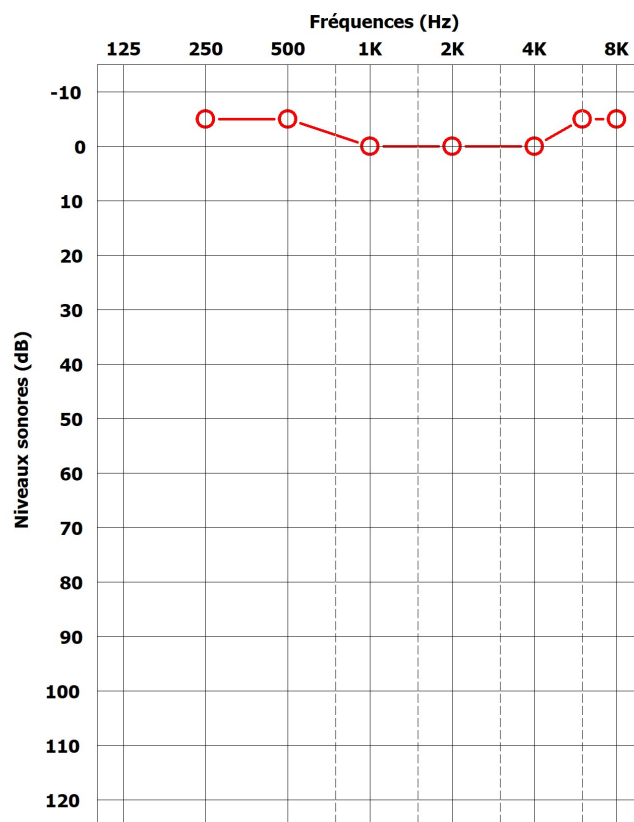

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-5	-5		-5		-5		-5	-5	-5
CA Droit		-5	-5		0		0		0	-5	-5

Calcul de perte	PAM
CA Gauche	---
CA Droit	---

Notes