


Données Patient	FAN BENQUIANG
Date de naissance	16/06/1984
Age	39
Société	COVEC
ID	24020711514436214


Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

Date du test: 07/02/2024 11:54:55
Durée: 4mn 37s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

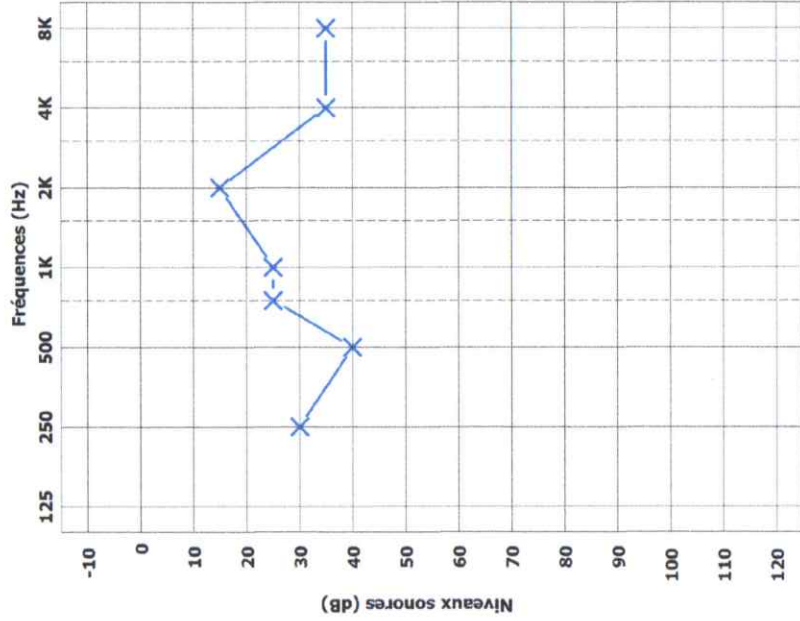

Oreille Gauche

CA Gauche	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Droit			20	30	25	25	15		35		35
Calcul de perte	PAM		IPA								
CA Gauche	28,8 dB		---								
CA Droit	32,5 dB		---								

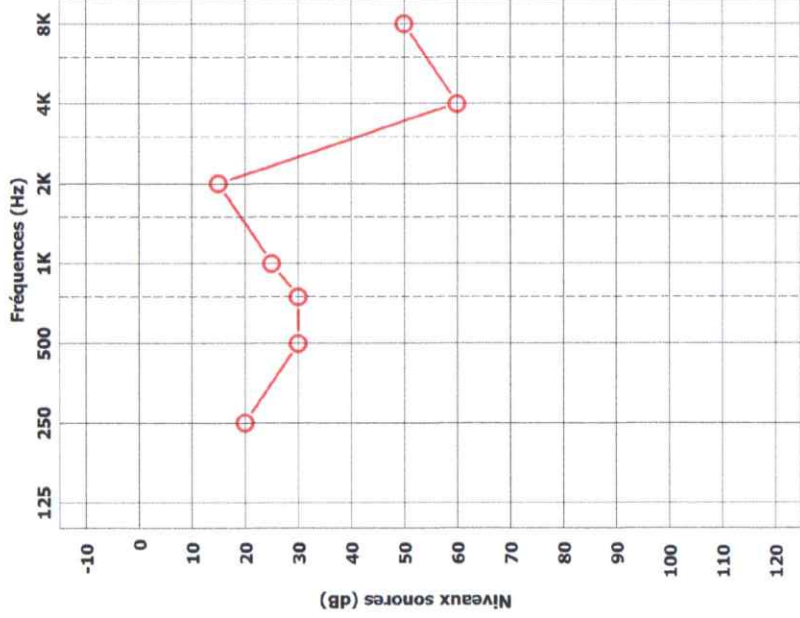

Oreille Droite

CA Gauche	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Droit			20	30	25	25	15		35		35
Calcul de perte	PAM		IPA								
CA Gauche	28,8 dB		---								
CA Droit	32,5 dB		---								

Notes