


MEDVIE


Date du test: 24/02/2024 19:01:21
Durée: 4mn 19s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KOÏVOGUI FRANCOIS	
Date de naissance	01/01/2000
Age	24
Société	COVEC
ID	24022418591243026

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

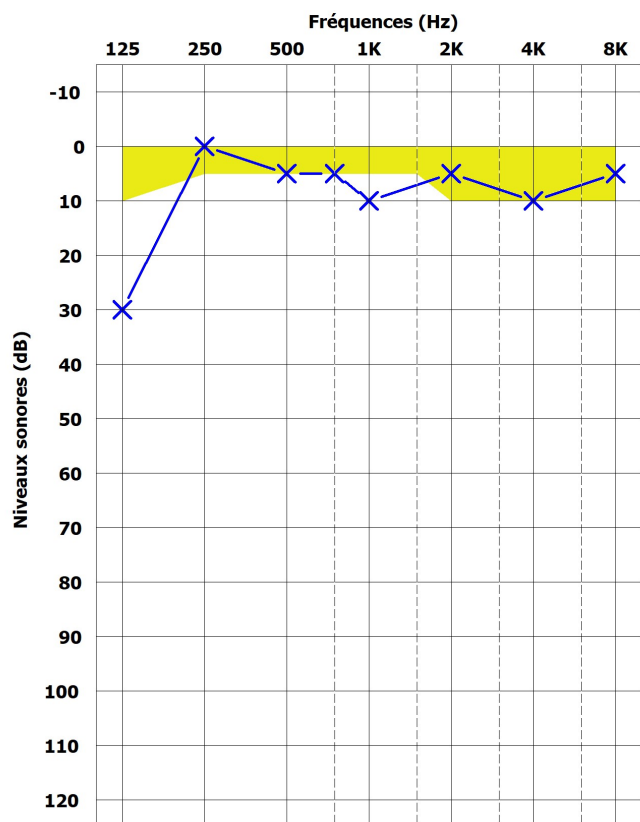

Oreille Gauche

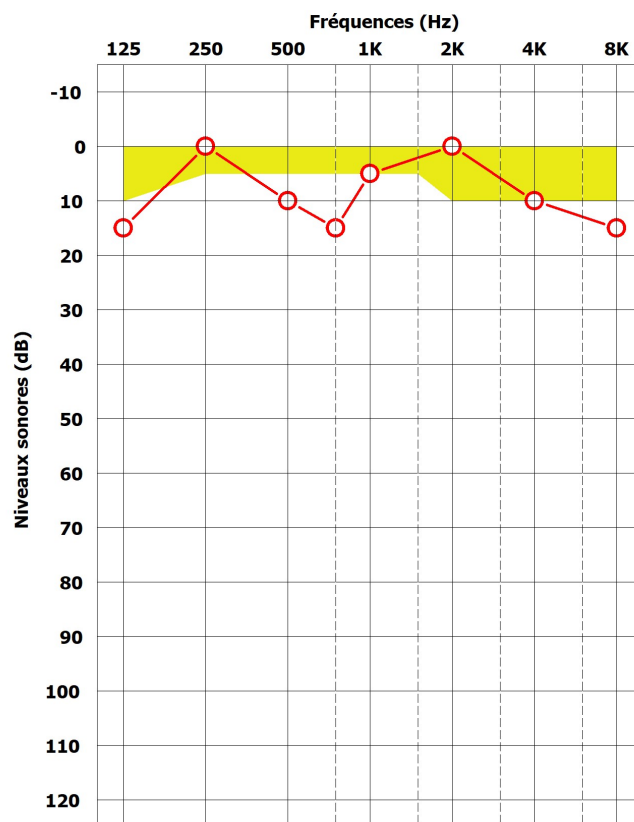

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	30	0	5	5	10		5		10		5
CA Droit	15	0	10	15	5		0		10		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	7,5 dB	---
CA Droit	6,3 dB	---

Notes